Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
Pinces-gouges

F-line PS

6611-00 F	F-line
devemed	150 mm 30 °

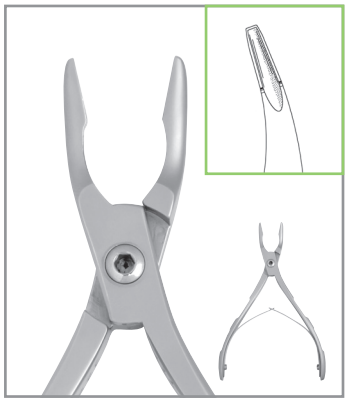

6611-01 F	F-line
devemed # F	150 mm 30 °

6611-02 F	F-line
devemed # S	145 mm 30 °

6825-10 F	F-line
Friedmann	145 mm 30 °

6825-10S F	F-line
Mini Friedmann mod.	145 mm 30 °

6825-11 F	F-line
Luer # 1	140 mm 30 °

Hohlmeißelzangen
Bone rongeurs
Pinces-gouges

825-40

825-40	
Ruskin	180 mm 15°

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication

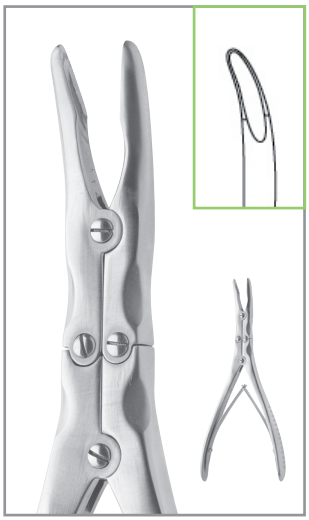

825-41	
Beyer	180 mm 15°

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication

Knochensplitterzangen
Bone cutting forceps
Pince coupante à os

825-16	
Cleveland # 5	170 mm 30°

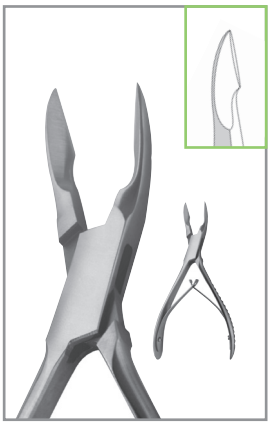

825-29	
Cleveland # 5s	140 mm 30°

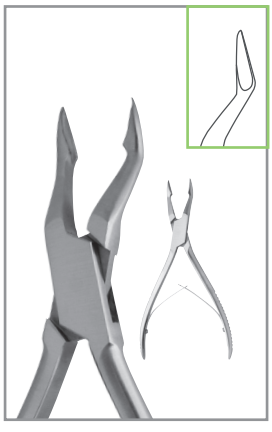

825-60	
# 18	170 mm

825-70	0°
825-71	15°
Ruskin-Liston	185 mm

mit Übersetzung
with double action
avec multiplication

Einsatz der Sinus-Lift-Instrumente | extern
Utilization of the Sinus-Lift instruments | extern
Utilisation des instruments Sinus-Lift | extérieur

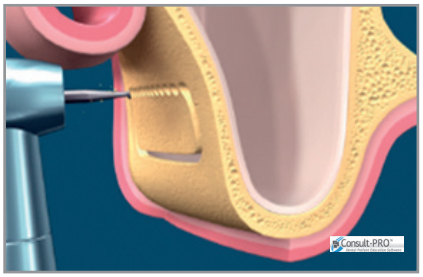

Ablösen der Gingiva, anschließend Öffnung eines Sinus-„Fensters“ mit einem diamantierten Kugelbohrer.

Elevation of the gingiva, followed by opening a sinus „window“ with a diamond ball drill.

Élévation de la gencive, puis ouverture d’une «fenêtre sinusale» au moyen d’un foret à boule diamanté.

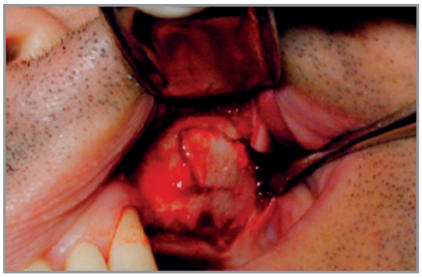

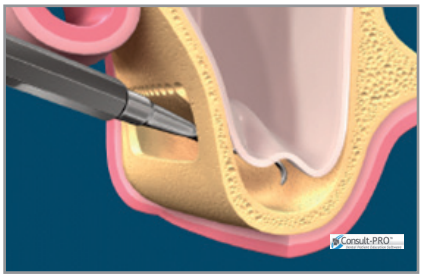

Lösen der Schneiderschen Membran vom Knochen mit speziell gebogenen Sinus-Lift-Elevatorien (oder Sinus-Lift-Küretten). Zusätzlicher Schutz der Membran durch Einklappen des „Knochenfensters“.

Detaching the Schneiderian membrane from the bone with specially curved sinus lift elevators (or sinus lift curettes). Additional protection of the membrane by folding in the „bone window“.

Décollement de la membrane de Schneider du tissu osseux au moyen d’élévateurs de sinus à courbure spécifique (ou de curettes pour élévation de sinus). Protection supplémentaire de la membrane par la fermeture du volet de la « fenêtre osseuse ».

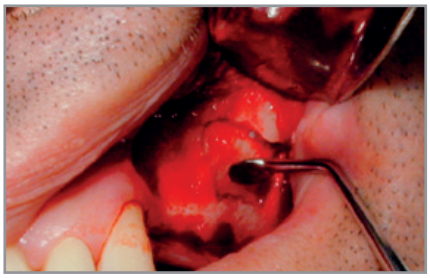

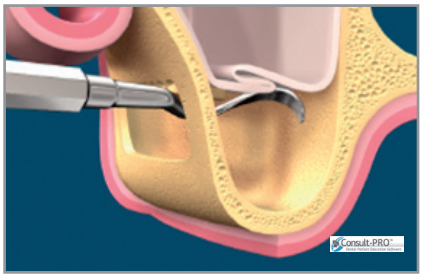

Vermessung und Aufbereitung des knöchernen Implantatbettes.

Measurement and preparation of the bony implant bed.

Mesure et conditionnement du lit implantaire osseux.

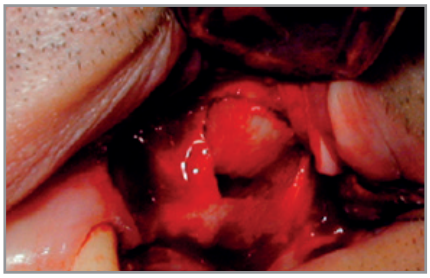

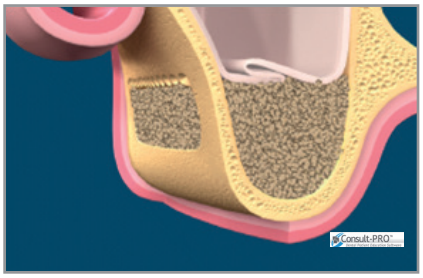

Einbringung des Knochen(-ersatz)materials

Insertion of the bone (replacement) material.

Implantation du matériau osseux (de substitution)

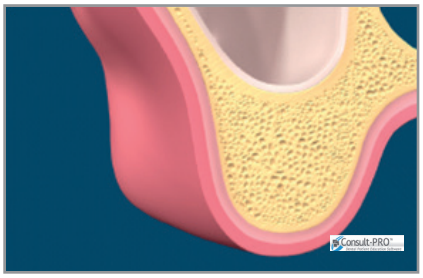

Nach dem Nähen und Fixieren der Schleimhaut beginnt die Umwandlung in festen Knochen.

The transformation into firm bone begins after suturing and fixation of the mucosa.

Suite à la suture et à la fixation de la muqueuse, il se produit une transformation en un tissu osseux rigide.

Images provided by
www.consult-pro.com
Consult-PRO™ Dental Patient Education Software

SINUS-LIFT SET – SMALL

SINUS-LIFT SET – SMALL

SINUS-LIFT SET – SMALL

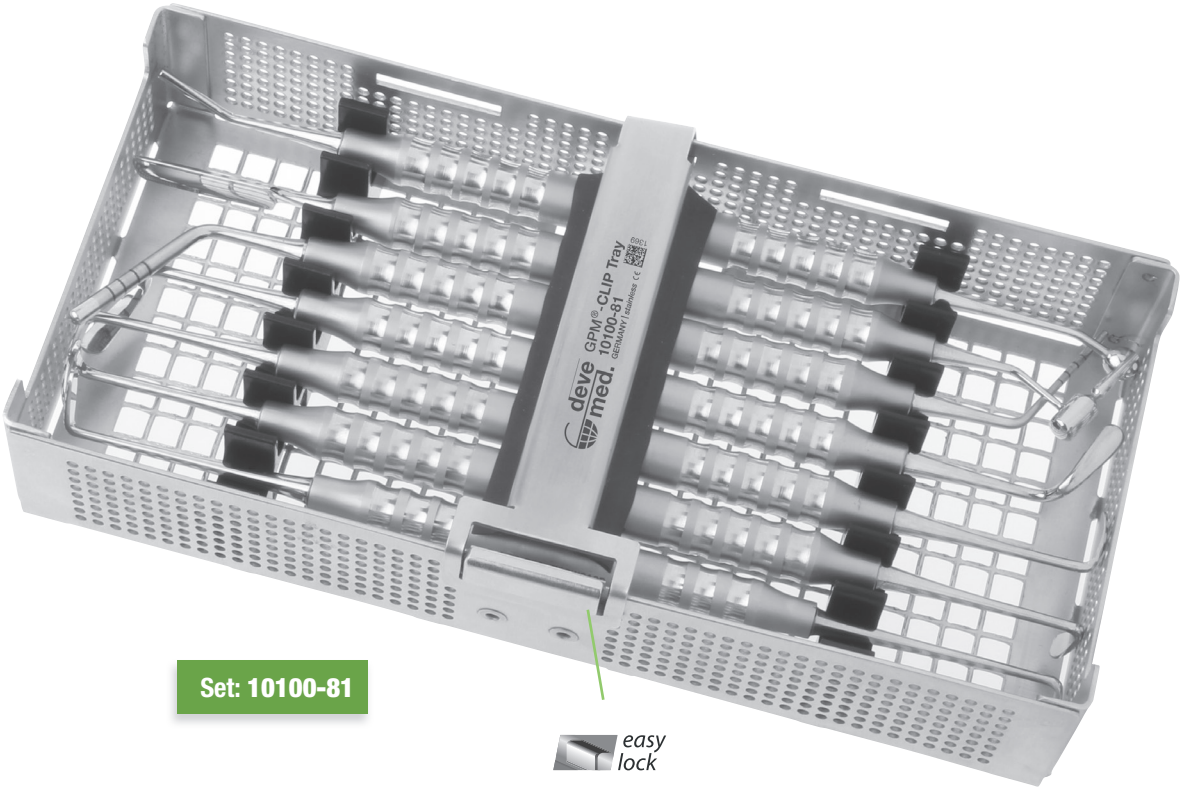

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-81 Item no. of the set: 10100-81 Set complet réf.: 10100-81
922-60 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 1	171 mm
922-61 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 2	171 mm
922-62 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 3	171 mm
922-64 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift élévateur „Mazor“ # 5	171 mm
2500-21 F F-line	Membran Lift / Granulatstopfer „Mazor“ # 6 Membrane lift / Granulate plugger „Mazor“ # 6 Lift membrane / Fouloir à granulat “Mazor“ # 6	171 mm, 6,0 mm / 2,0 mm
2406-91 F F-line	Tiefenmeßgerät „Mazor“ # 7 Depth gauge „Mazor“ # 7 Jauge de profondeur „Mazor“ # 7	171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduiert 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduated 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm, graduée
2500-42 F F-line	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour augementation chrirugie
9200-70 easy lock	GPM Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

SINUS-LIFT SET – LARGE

SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE

Set: 10100-82

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-82 Item no. of the set: 10100-82 Set complet réf.: 10100-82
2302-50 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection à griffe, micro	171 mm, 1x2, 0,8 mm, gerade 171 mm, 1x2, 0,8 mm, straight 171 mm, 1x2, 0,8 mm, droit
2302-71 F F-line	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezers, micro Pince à dissection á griffe, micro	171 mm, 0,8 mm, gebogen, TC 171 mm, 0,8 mm, curved, TC 171 mm, 0,8 mm, courbé, TC
2385-00 F F-line	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
2525-10 F F-line	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm, graduiert 171 mm, graduated 171 mm, graduation
1151-30 F F-line	Skalpellgriff # 3 Scalpel handle # 3 Manche p. bistouri # 3	158 mm, gerade, passend für 1 Klinge 158 mm, straight, suitable for 1 blade 158 mm, droit, pour 1 lame

SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE
SINUS-LIFT SET – LARGE

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-82 Item no. of the set: 10100-82 Set complet réf.: 10100-82
888-M3S F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 3S mod. Periosteal elevator „Mazor“ # 3S mod. Décolleur „Mazor“ # 3S mod.	171 mm, gerade 171 mm, straight 171 mm, droit
888-M1 F F-line	Raspatorium „Mazor“ # 1 Periosteal elevator „Mazor“ # 1 Décolleur „Mazor“ # 1	171 mm
922-60 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 1 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 1	171 mm
922-61 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 2 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 2	171 mm
922-62 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 3 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 3	171 mm
922-64 F F-line	Sinus-Lift Elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift elevator „Mazor“ # 5 Sinus-Lift élévateurs „Mazor“ # 5	171 mm
2500-21 F F-line	Membran Lift / Granulatstopfer „Mazor“ # 6 Membrane lift / Granulate plugger “Mazor“ # 6 Lift membrane / Fouloir à granulat “Mazor“ # 6	171 mm, 6,0 mm, 2,0 mm
2406-91 F F-line	Tiefenmeßgerät „Mazor“ # 7 Depth gauge „Mazor“ # 7 Jauge de profondeur „Mazor“ # 7	171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduiert 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduated 171 mm, 1,5 mm / 3,0 mm; graduée
2500-42 F F-line	Universal Instrument „Mazor“ Universal instrument „Mazor“ Instrument universel „Mazor“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour augementation chrirugie
998-21	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ modifiziert Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ modified Ecarteur des joues„University of Cawood-Minnesota“ mod.	155 mm
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25 cc, Ø 60,0 mm
1086-20 F F-line	Mikro-Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	171 mm, TC, 1,2 mm, gerade 171 mm, TC, 1,2 mm, straight 171 mm, TC, 1,2 mm, droit
1165-2	Chirurgische Schere „Goldman-Fox“ Surgical scissors „Goldman-Fox“ Ciseaux chirurgicaux „Goldman-Fox“	130 mm, gebogen 130 mm, curved 130 mm, courbés
2426-60	Chirurgischer Absauger Suction cannula Tube d‘aspiration	140 mm, Ø 6 mm, mit Bohrung 140 mm, Ø 6 mm, with hole 140 mm, Ø 6 mm, avec alésage
9200-10 easy lock	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée

Sinus-Lift Elevatorien – flexibel | anpassbar
Sinus-Lift elevators – flexible | adaptable
Sinus-Lift élévateurs – flexible | adaptable

F-line SL

Die biegbaren Arbeitsenden sind für die normalen Gegebenheiten vorgebogen. Diese können aber durch vorsichtiges Nachbiegen der Arbeitsenden an die örtliche Anatomie angepasst werden und erleichtern somit die Arbeit.

The flexible work-ends are pre-bent to suit normal circumstances. They can be carfully re-bent and customised to the local anatomy, greatly facilitating the work.

Les parties travaillantes flexibles sont précourbés pour les circonstances normales. Elles peuvent être recourbés prudamment afin de les adapter à l´anatomie locale désirée, ce qui facilite le travail du praticien.

922-55 F	F-line
# A6 Lorean/Barbu	171 mm

922-56 F	F-line
# A7 Lorean/Barbu	171 mm

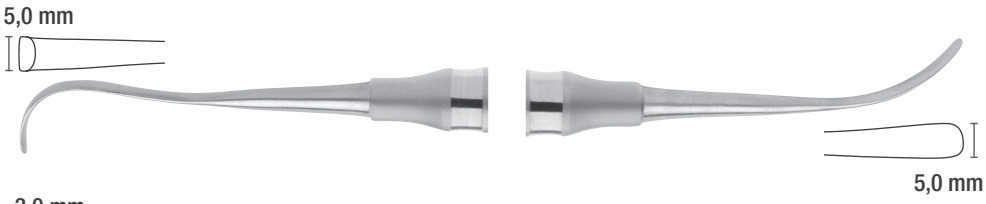

922-57 F	F-line
# A6 mod.	171 mm
flexibel / anpassbar flexible / adaptable flexible / adaptable	

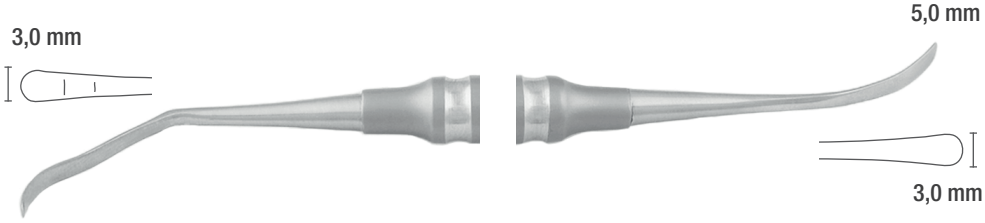

922-58 F	F-line
# A7 mod.	171 mm
flexibel / anpassbar flexible / adaptable flexible / adaptable	

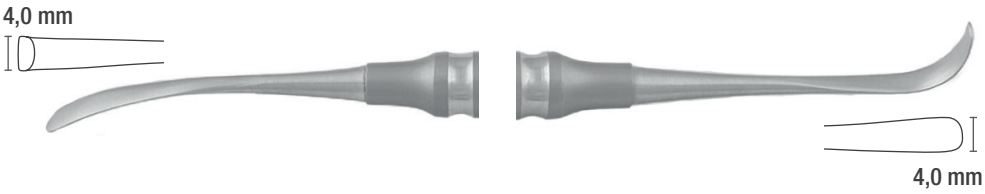

Sinus-Lift Elevatorien
Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift élévateurs

923-70 F	F-line
	171 mm

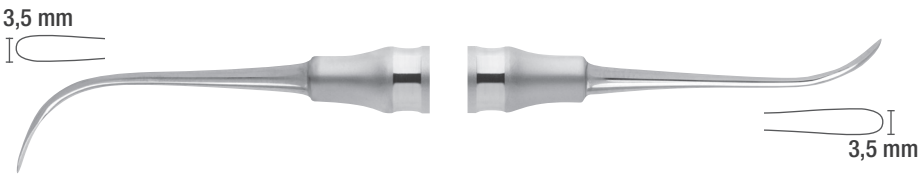

923-73 F	F-line
	171 mm

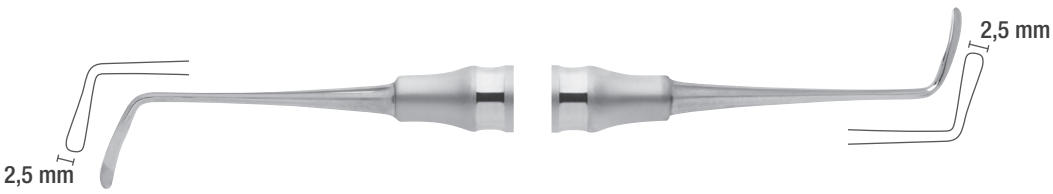

Sinus-Lift Elevatorien
Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift élévateurs

F-line SL

923-76 F	F-line
	171 mm

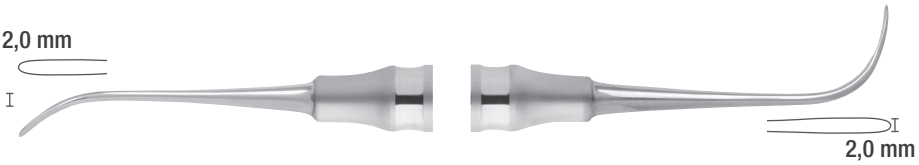

922-60 F	F-line
Mazor # 1	171 mm

922-61 F	F-line
Mazor # 2	171 mm

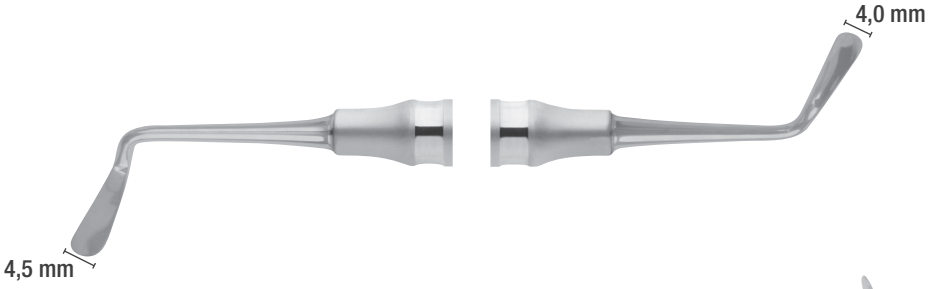

922-62 F	F-line
Mazor # 3	171 mm

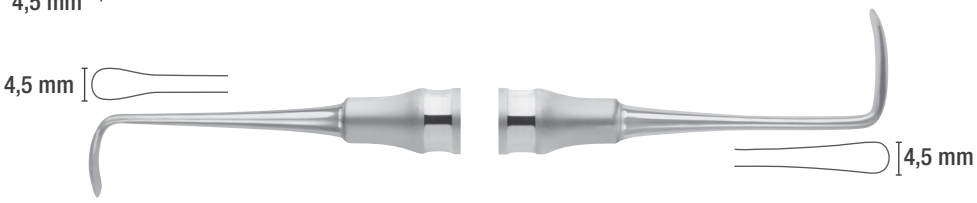

922-63 F	F-line
Mazor # 4	171 mm

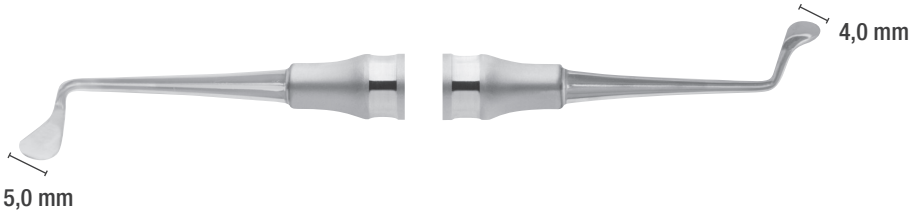

922-64 F	F-line
Mazor # 5	171 mm

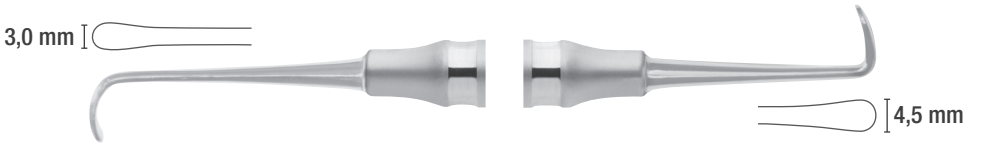

922-10 F	F-line
# A1	171 mm

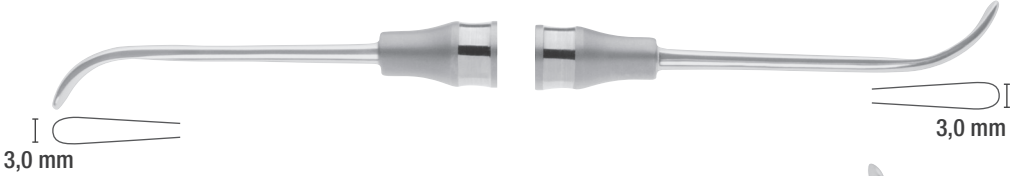

922-20 F	F-line
# A2	171 mm

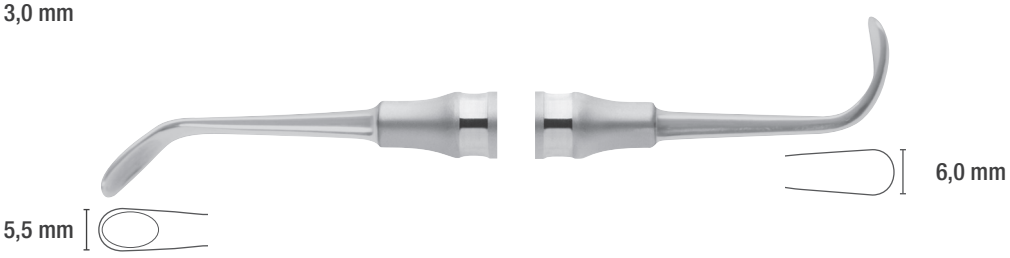

Sinus-Lift Elevatorien
Sinus-Lift elevators
Sinus-Lift élévateurs

F-line SL

922-30 F	F-line
# A3	171 mm

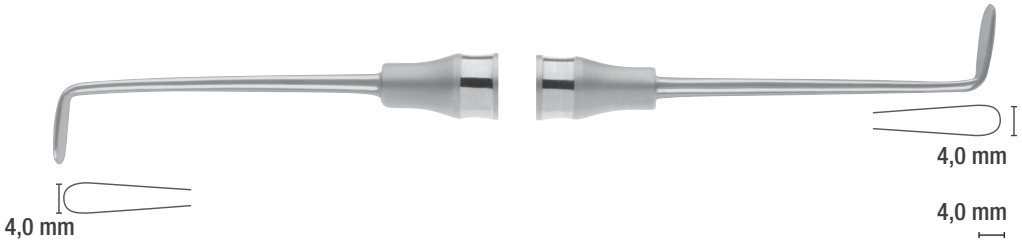

922-40 F	F-line
# A4	171 mm

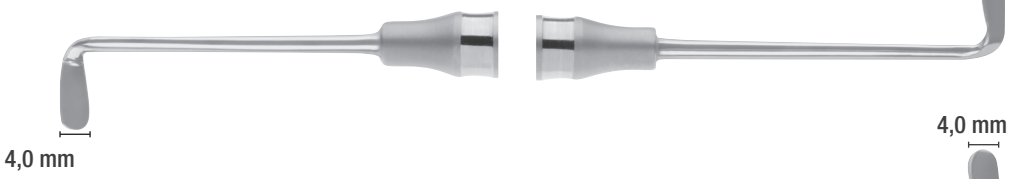

922-50 F	F-line
# A5	171 mm

921-10 F	F-line
Palti # 1	171 mm

921-11 F	F-line
Palti # 2	171 mm

923-60 F	F-line
Tatum/Palti	150 mm

Die leichte Flexibilität der Sinus-Lift Küretten vermindert die Verletzungsgefahr der Membrane und steigert das operative Feingefühl.

Injuries to the membrane are prevented and operating sensitivity increases, due to the flexibilty of the Sinus-Lift curettes.

La fléxibilité des curettes Sinus-Lift minimalise le risque de blessures de la membrane et augmente ainsi la sensibilité opératoire.

923-80 F	F-line
	171 mm

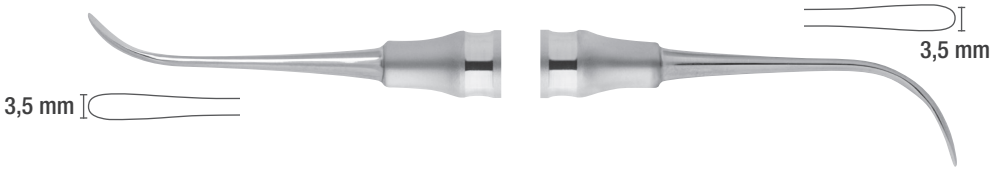

Sinus-Lift Küretten
Sinus-Lift curettes
Sinus-Lift curettes

F-line SL

923-83 F	F-line
	171 mm

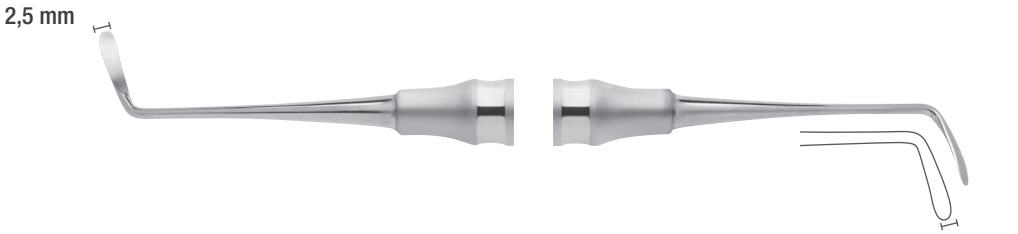

923-86 F	F-line
	171 mm



Sinus-Lift Kürette | TRInity 1
Sinus-Lift curette | TRInity 1
Sinus-Lift curette | TRInity 1

Das Instrument wird verwendet, um den Sinusboden zu erreichen. Die Rückseite dient dem Erreichen der medialen Wand.

The instrument is used to reach the sinus floor. The back is used to reach the medial wall.

L'instrument est utilisé pour atteindre le plancher du sinus. L'arrière sert à atteindre le mur médian.

924-10 FT	F-line
	171 mm

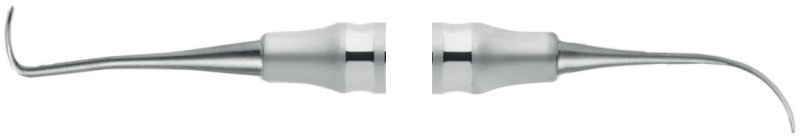

Titan, scharf
Titanium, sharp
Titane, tranchante

Sinus-Lift Mikro-Schaber | TRInity 2
Sinus-Lift micro-scraper | TRInity 2
Sinus-Lift micro-grattoir | TRInity 2

Für die Membranablösung in engen Bereichen. Beide Enden sind scharf und ermöglichen eine taktile Sinus-Elevation.

For membrane detachment in narrow areas. Both ends are sharp and enable tactile sinus elevation.

Pour le décollement de la membrane dans des zones étroites. Les deux extrémités sont tranchantes et permettent une élévation sinusoïdale tactile.

924-20 F	F-line
	171 mm

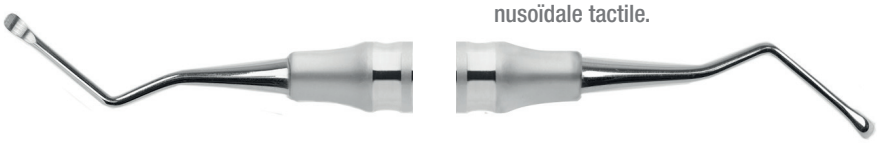

Scharf
Sharp
Tranchante

Sinus-Lift Schaber / Applikator | TRInity 3
Sinus-Lift scraper / applicator | TRInity 3
Sinus-Lift grattoir / applicateur | TRInity 3

Zum Lösen der Membran und um Knochenersatzmaterial in der Kieferhöhle anzubringen.

To loosen the membrane and to attach bone replacement material in the maxillary sinus.

Pour détacher la membrane et pour appliquer un matériau de substitution osseuse dans le sinus maxillaire.

924-30 F	F-line
	171 mm

Scharf
Sharp
Tranchante

RIDGE SPLITTING SET
RIDGE SPLITTING SET
RIDGE SPLITTING SET

Set: 10100-22

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-22 Item no. of the set: 10100-22 Set complet réf.: 10100-22
2500-30 F	Applikator Applicator Applicateur	171 mm, für Knochenmaterial 171 mm, for bone grafting material 171 mm, pour matériaux osseux
2800-30 F	Knochenschaber „Steigmann“ Bone scraper „Steigmann“ Râpe à os courbee „Steigmann“	171 mm, zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial 171 mm, for recovering autologous bone material 171 mm, pour gagner le matérial d‘os autologue
2500-35 F	Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	171 mm, für Augmentationschirurgie 171 mm, for augmentation surgery 171 mm, pour chirurgie augmentation
2385-00 F	Mundspiegelgriff I M 2,5 Mouth mirror handle I M 2,5 Manche à miroir I M 2,5	135 mm
2501-90 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 4,0 mm, gerade, graduiert 171 mm, 4,0 mm, straight, graduated 171 mm, 4,0 mm, droit, gradué
2501-92 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 8,0 mm, gerade, graduiert 171 mm, 8,0 mm, straight, graduated 171 mm, 8,0 mm, droit, gradué
2501-95 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 4,0 mm, gebogen, graduiert 171 mm, 4,0 mm, curved, graduated 171 mm, 4,0 mm, courbé, gradué
2501-97 F	Flachmeißel Bone chisel Ciseau-burin à os	171 mm, 8,0 mm, gebogen, graduiert 171 mm, 8,0 mm, curved, graduated 171 mm, 8,0 mm, courbé, gradué
2501-98 F	Flachmeißel „Kramer-Nevins“ Bone chisel „Kramer-Nevins“ Ciseau-burin à os „Kramer-Nevins“	171 mm, gerade, 5,0 mm 171 mm, straight, 5,0 mm 171 mm, droit, 5,0 mm
825-60	Knochensplitterzange # 18 Bone cutting forceps # 18 Pince coupante à os # 18	170 mm, mit auswechselbaren Kunststoffeinsätzen 170 mm, with interchangeable plastic inserts 170 mm, avec plaques à changer en matière plastique
860-50 F	Hammer „Vickers“ Mallet „Vickers“ Maillet „Vickers“	170 mm, 180 g
9100-12	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée

Kieferkammspaltung
Ridge-Splitting
Segmentation Alveolaire

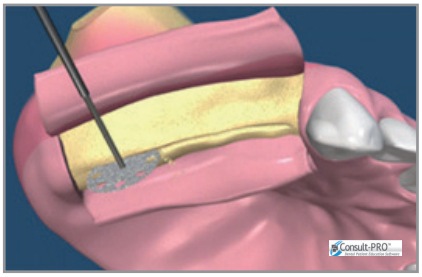

Um die Markierung der Frakturlinie im OK anzubringen wird eine diamantierte Scheibe benutzt.

A diamond-coated disk is used to mark the fracture line on the upper jaw.

Pour marquer la ligne de fracture dans le maxillaire, on utilise un disque diamanté.

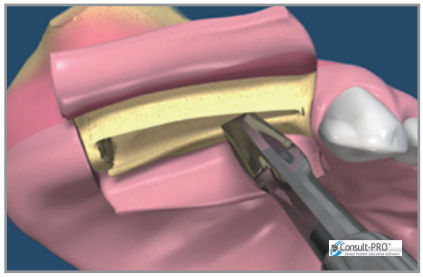

Beim eigentlichen Ridge-Splitting wird beim Erweitern bzw. der Luxierung des Kieferkamms ein Flachmeißel eingesetzt.

A flat chisel is used for the widening/luxation of the alveolar ridge in the actual ridge-splitting process.

Pour la méthode Ride-Splitting, on se sert d´un ciseau-burin qui permet l´ouverture et l´étirement de la crête alvéolaire.

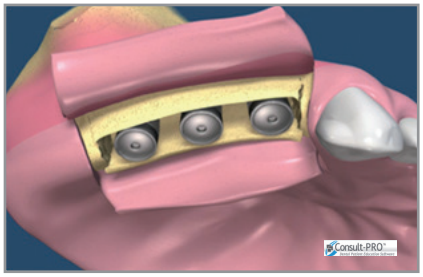

Nach dem Einsetzen der Implantate sieht man die bei dem Eingriff (Ridge-Splitting) entstehenden Auffüllflächen.

After the implants have been inserted, the filling areas can be seen resulting from the ridge-splitting.

Après le placement des implants et l´intervention par la méthode Ridge-Splitting, on aperçoit les surfaces à couvrir.

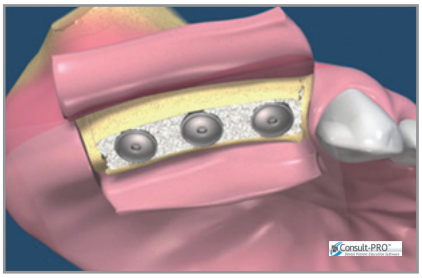

Diese Auffüllflächen werden in diesem Beispiel mit Knochenersatzmaterial großzügig gefüllt.

In this example, these filling areas have been generously filled with bone grafting material.

Les surfaces autour des implants seront recouverts avec du matériau de comblement.

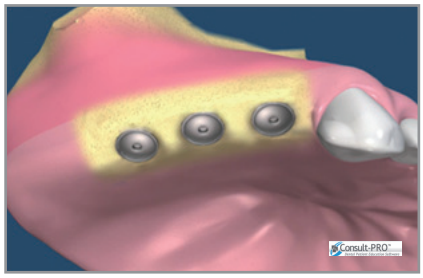

Nach rund sieben Monaten Einheilungsphase wird die Kieferkammverbreiterung deutlich.

After about seven months of regeneration, the widening of the ridge is clearly visible.

Après une cicatrisation d´environ sept mois, on peut constater une extension de la crête alvéolaire.

Images provided by www.consult-pro.com

Hammer
Mallets
Maillets

F-line PH

860-50 F	F-line
Vickers	170 mm 180 g

Hohlgriff
Hollow handle
Poignée creuse

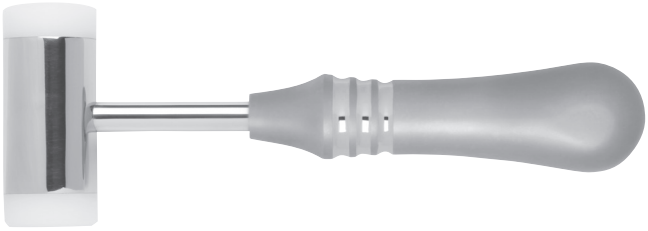

mit auswechselbarem Kunststoffeinsatz aus Teflon
with interchangeable plastic insert made from teflon
avec plaque en plastique interchangeable en téflon

860-50 A
Kunststoffeinsatz Plastic insert Plaque en plastique

für 860-50 F
for 860-50 F
pour 860-50 F

860-2	
	165 mm 140 g

bleigefüllt
lead filled
remplit de plomb

860-4	
Mead	190 mm 320 g

860-4 E
Kunststoffeinsätze (2 Stück) Plastic inserts (2 units) Plaques en plastique (2 unités)

für 860-4
for 860-4
pour 860-4

Knochenspreizer
Bone Spreader
Ecarteur de l'os

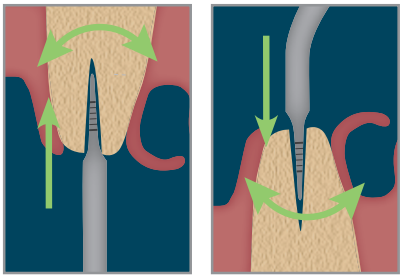

Der Kieferkamm wird für das Bone Spreading mit einer rotierenden Scheibe oder mit einem feinen Meisel vorbereitet. Um das Implantatlager zu erhalten erfolgt die sagittale Spreizung des Kieferkamms mit den ellipsenförmigen Knochenspreizen.

The alveolar ridge is prepared for bone spreading with a rotating disk or with a fine chisel. Use the elliptical spreaders to sagittally widen the alveolar ridge, in order to maintain the implant site.

Pour pouvoir faire l'extension d´os, la crête osseuse est préparée avec un disque rotatif ou avec un ciseau-burin très fin. La préparation du lit implantaire est faite avec un écartement sagittale de la crête osseuse avec les instruments elliptiques.



2508-16 F	1,6 mm	2,2 mm
2508-22 F	2,2 mm	2,8 mm
2508-28 F	2,8 mm	3,4 mm
2508-34 F	3,4 mm	4,0 mm
5-6-7-8-9-10	171 mm	

gerade, graduiert, nicht kalibriert
straight, graduated, non-calibrated
droit, gradué, non calibré

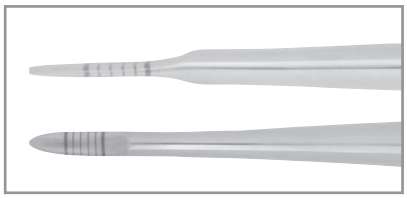

besonders für den Frontzahnbereich geeignet
particularly suitable for the front teeth area
approprié pour les dents antérieures

2509-16 F	1,6 mm	2,2 mm
2509-22 F	2,2 mm	2,8 mm
2509-28 F	2,8 mm	3,4 mm
2509-34 F	3,4 mm	4,0 mm
5-6-7-8-9-10	171 mm	

bajonett, graduier, nicht kalibriert
bayonet, graduated, non-calibrated
baïonnette, gradué, non calibré

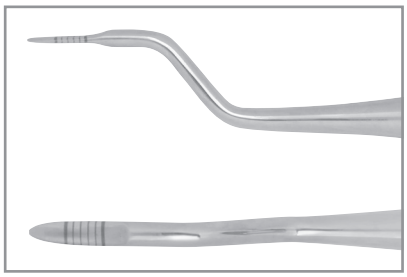

für den molaren und prämolaren Bereich geeignet
suitable for the area of molars and premolars
approprié pour les molaires et prémolaires

Knochenmeißel
Bone chisels
Ciseaux-burins

F-line RS

Durch das scharfe Ende des Meißels kann der Kieferkamm, nach dem Einsatz einer Diamantscheibe oder einer Knochenfräse, optimal geöffnet und gedehnt werden. Die Graduierung im Abstand von 2 mm gewährleistet eine präzise Überwachung der Eindringtiefe.

The sharp workpiece end can be used to optimally open and stretch the alveolar ridge, after the use of a diamond cutting wheel. The 2 mm graduations ensure precise monitoring of the penetration depth.

Grâce à l´extrémité très tranchante, l´ouverture et l´étirement de la crête alvéolaire est possible, après l´utilisation d´un disque diamanté. La graduation par intervalle de 2 mm garantie un contrôle exact de la profondeur.

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré

2501-90 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
gerade
straight
droit

2501-92 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
gerade
straight
droit

2501-95 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
abgewinkelt
angled
angulé

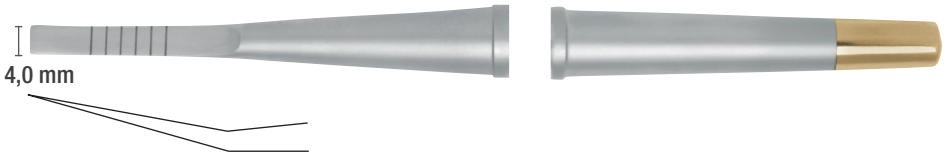

2501-97 F F-line
171 mm
8-10-12-14-16-18
abgewinkelt
angled
angulé

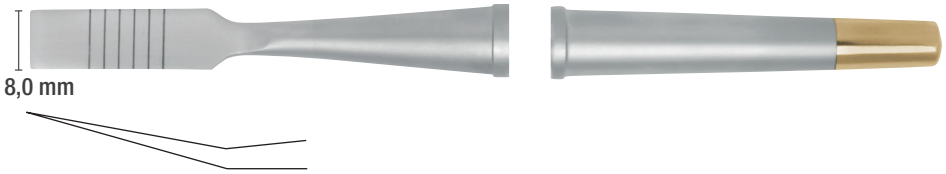

2501-98 F F-line
Kramer-Nevins
171 mm
gerade
straight
droit

BONE SPREADING SET

BONE SPREADING SET
BONE SPREADING SET

Set: 10100-23

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-23 Item no. of the set: 10100-23 Set complet réf.: 10100-23
2502-40 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	4,0 mm, 171 mm, graduiert 4,0 mm, 171 mm, graduated 4,0 mm, 171 mm, graduée
2502-60 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	6,0 mm, 171 mm, graduiert 6,0 mm, 171 mm, graduated 6,0 mm, 171 mm, graduée
2502-80 F F-line	Knochenmeißel, spitz zulaufend Bone chisels, tapered Ciseaux burins à os, s'effiler	8,0 mm, 171 mm, graduiert 8,0 mm, 171 mm, graduated 8,0 mm, 171 mm, graduée
2506-35 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	3,5 mm, 171 mm, graduiert 3,5 mm, 171 mm, graduated 3,5 mm, 171 mm, graduée
2506-50 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	5,0 mm, 171 mm, graduiert 5,0 mm, 171 mm, graduated 5,0 mm, 171 mm, graduée
2506-70 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	7,0 mm, 171 mm, graduiert 7,0 mm, 171 mm, graduated 7,0 mm, 171 mm, graduée
2507-35 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	3,5 mm, 171 mm, graduiert 3,5 mm, 171 mm, graduated 3,5 mm, 171 mm, graduée
2507-50 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	5,0 mm, 171 mm, graduiert 5,0 mm, 171 mm, graduated 5,0 mm, 171 mm, graduée
2507-70 F F-line	Knochenspreizer Bone Spreader Ecarteur de l'os	7,0 mm, 171 mm, graduiert 7,0 mm, 171 mm, graduated 7,0 mm, 171 mm, graduée
9200-80 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm

Knochenmeißel, spitz zulaufend
Bone chisels, tapered
Ciseaux burins à os, s'effiler

F-line RS

Der Spitzmeißel wird für die erste Weitung des Kieferkamms verwendet.

The pointed chisel is used for the initial widening of the alveolar ridge.

Le ciseau burin est utilisé pour un premier élargissement de la crête osseuse.

2502-40 F F-line	4,0 mm	
2502-60 F F-line	6,0 mm	
2502-80 F F-line	8,0 mm	
6-8-10-12-14	171 mm	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré

Knochenspreizer
Bone Spreader
Ecarteur de l'os

2506-35 F	3,5 mm
2506-50 F	5,0 mm
2506-70 F	7,0 mm
6-8-10-12-14	171 mm

flach, graduiert, nicht kalibriert
plane, graduated, non-calibrated
plate, gradué, non calibré

2507-35 F	3,5 mm
2507-50 F	5,0 mm
2507-70 F	7,0 mm
6-8-10-12-14	171 mm

oval, graduiert, nicht kalibriert
oval, graduated, non-calibrated
ovale, gradué, non calibré

Knochenspreizer, konisch
Bone Spreader, conical
Ecarteur de l'os, conique

Durch das Ankörnen des Knochens kann das Implantat besser eingeschraubt werden. (Kein Abrutschen oder schiefes Eindrehen)

The implant can be better screwed in by punching the bone (no movement out of place or screwing in askew).

Grâce au perçage dans l´os, l´implant se laisse visser plus facilement (sans glissement ou vissage oblique).

2506-00 F	
Vivas	171 mm
6-8-10-12-14	

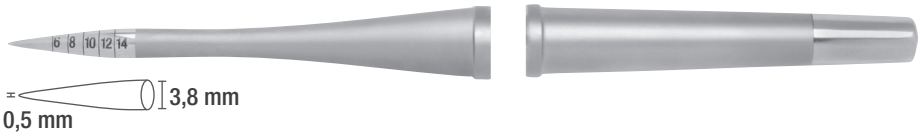

konisch, graduiert, nicht kalibriert
conical, graduated, non-calibrated
conique, gradué, non calibré

BONE CONDENSING SET
BONE CONDENSING SET
BONE CONDENSING SET

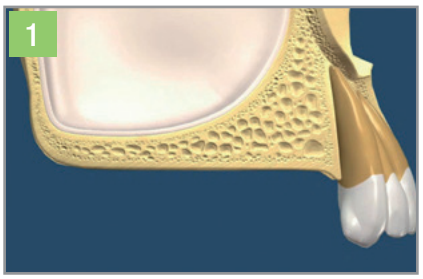

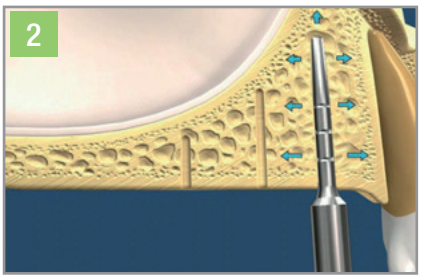

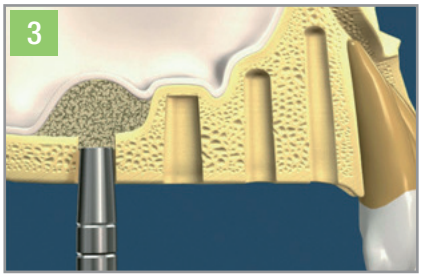

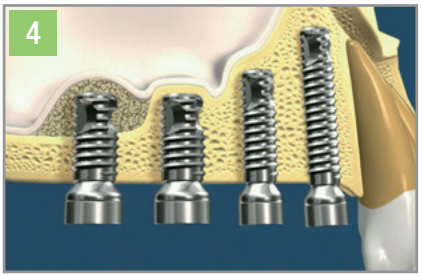

1 Nach der Extraktion muss mit einer Ausdehnung der Kieferhöhle, sowie mit einer Kieferkammresorption gerechnet werden. Falls dieser Fall eintritt, sollte kondensiert werden.

After the extraction an extension of the maxillary sinus and resorption of the ridge can be expected. If this occurs, bone condensation should be applied.

Après une extraction, on constate souvent une résorption osseuse du sinus maxillaire et de la crête alvéolaire. Dans ce cas il est indispensable de faire une condensation osseuse.

2 Bei einer geschlossenen Sinusbodenelevation in Verbindung mit einer lateralen Kondensation (Bone Condensing) wird eine Pilotbohrung mit 2 mm Durchmesser bis zum kortikalen Boden der Kieferhöhle durchgeführt. Bei der Einführung des ersten Osteotoms (am besten Art No. 2821-27 F) in die bereits vorgebohrte Kavität, sollte mit leichtem Druck oder leichten Hammerschlägen versucht werden, die Schneidersche Membran in der Kieferhöhle anzuheben.

When executing a closed sinus elevation in conjunction with a lateral condensation (Bone Condensing), a pilot hole with 2 mm diameter is trilled to the cortical floor of the maxillary sinus is made. When inserting the first osteotome (Art. No. 2821-27 F is recommended) into the predrilled cavity, attempts should be made with light pressure or light hammer blows to lift the Schneiderian membrane.

Pour une élévation fermée du plancher sinusien avec condensation latérale de l´os (Bone Condensing) on perce un trou de 2 mm de diamètre. Pour insérer le premier ostéotome (de préférence ref. 2821-27 F) dans la cavité préparée, on procède au soulèvement précautionneux de la membrane de Schneider.

3 Wenn Sie Ihren gewünschten Durchmesser erreicht haben, sollten Sie mit dem jeweiligen Bone-Pusher das Augmentationsmaterial einbringen und kondensieren.

If you have reached the desired diameter, the augmentation material should be inserted and condensed with the respective bone pusher.

Après avoir atteint le diamètre voulu, vous pouvez procéder à l´augmentation et la condensation osseuse à l´aide des différents embouts fouloirs.

4 Wenn Sie die für das Implantat entsprechende Höhe erreicht haben (plus 2-3 mm beachten), werden die Implantate gesetzt. Bitte fragen Sie Ihren Implantat-Lieferanten nach den geeigneten Implantaten für diesen Eingriff. Ab jetzt beginnt die vier bis acht monatige Einheilphase.

When you have reached the appropriate height for the implants (plus 2-3 mm), they can be inserted. Please ask your implant supplier for correct implants for this surgical procedure. As from now on a healing period of between four to eight months begins.

Après avoir atteint la hauteur nécessaire pour la pose de l´implant (plus de 2-3 mm) le placement définitif de l´implant peut être effectué. Pour le choix de l´implant, veuillez consulter votre fournisseur d´implants. Le temps de cicatrisation dure environ quatre à huit mois.

Images provided by www.consult-pro.com

NEW

BONE CONDENSING SET – SMALL

BONE CONDENSING SET – SMALL
BONE CONDENSING SET – SMALL

Set: 10100-13

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-13 Item no. of the set: 10100-13 Set complet réf.: 10100-13
2824-27 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 2,7 mm
2824-32 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 3,2 mm
2824-37 F F-line	Osteotom, konvex, bajonett Osteotome, convex, bayonet Ostéotome, convexe, baïonnette	171 mm, 3,7 mm
2825-27 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 2,7 mm
2825-32 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 3,2 mm
2825-37 F F-line	Osteotom, konkav, bajonett Osteotome, concave, bayonet Ostéotome, concave, baïonnette	171 mm, 3,7 mm
860-50 F F-line	Hammer „Vickers“ Mallet „Vickers“ Maillet „Vickers“	170 mm, 180 g
9100-07 easy lock	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm

Osteotome und Bone Pusher
Osteotomes and bone pushers
Ostéotomes et fouloirs

F-line RS

2815-27 F F-line	2,7 mm
2815-32 F F-line	3,2 mm
2815-37 F F-line	3,7 mm
2815-42 F F-line	4,2 mm
2815-50 F F-line	5,0 mm
Bone Pusher, gerade Bone pusher, straight Fouloir-os, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2821-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2821-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2821-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2821-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2821-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2822-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2822-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2822-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2822-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2822-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

2816-27 F F-line	2,7 mm
2816-32 F F-line	3,2 mm
2816-37 F F-line	3,7 mm
2816-42 F F-line	4,2 mm
2816-50 F F-line	5,0 mm
Bone Pusher, bajonett Bone pusher, bayonet Fouloir-os, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2824-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2824-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2824-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2824-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2824-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2825-27 F F-line	2,0 < 2,7 mm
2825-32 F F-line	2,7 < 3,2 mm
2825-37 F F-line	3,2 < 3,7 mm
2825-42 F F-line	3,7 < 4,2 mm
2825-50 F F-line	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	171 mm
8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

Osteotom- und Bone Pusher Aufsätze
Osteotom and bone pushers tips
Ostéotomes et embouts de fouloirs

2815-27	2,7 mm
2815-32	3,2 mm
2815-37	3,7 mm
2815-42	4,2 mm
2815-50	5,0 mm
Bone Pusher, gerade Bone pusher, straight Fouloir-os, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2821-20	1,5 < 2,0 mm
2821-27	2,0 < 2,7 mm
2821-32	2,7 < 3,2 mm
2821-37	3,2 < 3,7 mm
2821-42	3,7 < 4,2 mm
2821-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2822-27	2,0 < 2,7 mm
2822-32	2,7 < 3,2 mm
2822-37	3,2 < 3,7 mm
2822-42	3,7 < 4,2 mm
2822-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, gerade Osteotome, straight Ostéotome, droit	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

2816-27	2,7 mm
2816-32	3,2 mm
2816-37	3,7 mm
2816-42	4,2 mm
2816-50	5,0 mm
Bone Pusher, bajonett Bone pusher, bayonet Fouloir-os, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

flach, graduiert, nicht kalibriert
flat, graduated, non-calibrated
plat, gradué, non calibré

2824-20	1,5 < 2,0 mm
2824-27	2,0 < 2,7 mm
2824-32	2,7 < 3,2 mm
2824-37	3,2 < 3,7 mm
2824-42	3,7 < 4,2 mm
2824-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konvex, graduiert, nicht kalibriert
convex, graduated, non-calibrated
convexe, gradué, non calibré

2825-27	2,0 < 2,7 mm
2825-32	2,7 < 3,2 mm
2825-37	3,2 < 3,7 mm
2825-42	3,7 < 4,2 mm
2825-50	4,2 < 5,0 mm
Osteotom, bajonett Osteotome, bayonet Ostéotome, baïonnette	60 mm
Palti, 8-10-12-14-16-18	

konkav, graduiert, nicht kalibriert
concave, graduated, non-calibrated
concave, gradué, non calibré

für Osteotom- und Bone Pusher Aufsatz
for osteotome- and bone pusher attachment
pour embouts d´ostéotomes et fouloirs à os

2811-00	
Palti	115 mm

Handgriff
Handle
Manche

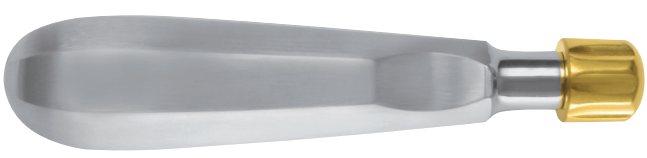

Schnellspanner
Quick release
Serrage rapide

Knochenschaber
Bone scraper
Râpe à os

F-line SL

Durch die scharfen Arbeitsenden wird die Kortikalis (Knochenrinde) ohne großen Kraftaufwand in feine Scheiben geschnitten. Für die optimale Schärfe empfehlen wir nach jeder Anwendung die Arbeitsteile mit einem Arkansasstein nachzuschleifen.

The sharp working ends allow the bone material to be cut into fine slices without great efforts. For optimum sharpness after each use we recommend that the tips are regrinded with an Arkansas stone.

Grâce aux parties tranchantes ces ciseaux permettent de couper des tranches osseuses fines. Pour l´affûtage, nous vous conseillons d´utiliser après chaque emploi la pierre Arkansas.

2800-30 F	F-line
Steigmann	171 mm

Knochenschaber
Bone scraper
Ciseau à os

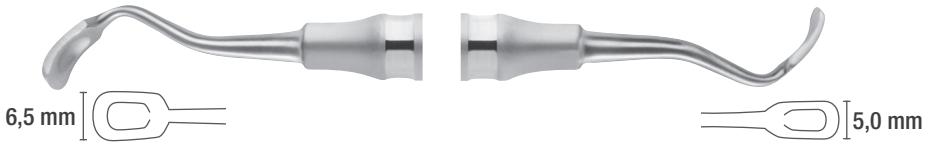

Knochenentnahme und -applikation
Bone extraction and application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2800-34 F	F-line	3,0 / 4,0 mm
2800-35 F	F-line	3,0 / 5,0 mm
2800-45 F	F-line	4,0 / 5,0 mm
Buser		171 mm

Knochenschaber
Bone scraper
Ciseau à os



Dieser Applikator gewährleistet ein optimales Anmischen und Transportieren von Knochenersatzmaterial. Für kleinere benötigte Mengen steht das schmale und bei größeren Mengen das breite Arbeitsteil zur Verfügung.

This applicator ensures the optimal blending and transportation of bone grafting material. The narrow workpiece is available for smaller and the wider workpiece for larger quantities.

Cet applicateur sert au transport et à la préparation de matériaux de comblement. L´extrémité fine s´utilise en cas de petits défauts, l´extrémité large en cas de grands défauts.

2500-30 F	F-line	
Palti		171 mm

Applikator
Applicator
Applicateur



2500-31 F	F-line	
Steigmann		171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

2500-32 F	F-line	
		171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-20 F F-line

„Mazor“ # 5	171 mm

Planstopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

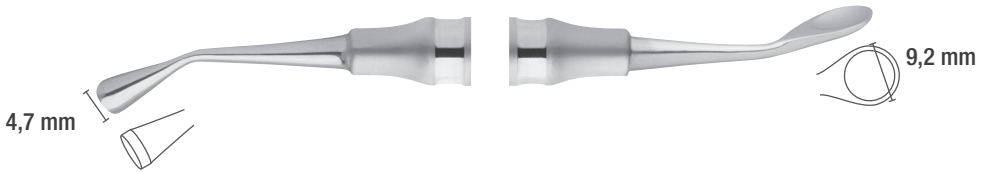

2500-33 F F-line

	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

2500-34 F F-line

	171 mm

Stopfer
Compactor
Compacteur

2500-36 F F-line

Biehler	171 mm

Membran Lift | Granulatstopfer
Membrane lift | Granulate plugger
Lift membrane | Fouloir à granulat

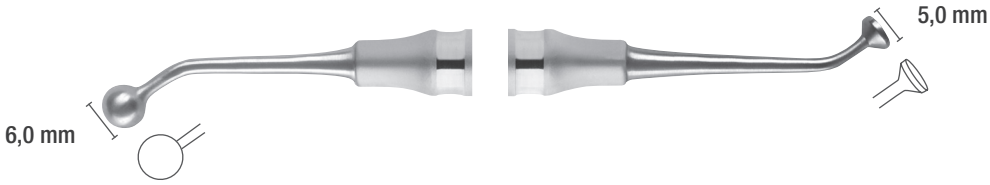

2500-21 F F-line

Mazor # 6	171 mm

Membran Lift | Granulatstopfer
Membrane lift | Granulate plugger
Lift membrane | Fouloir à granulat

Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-37 F F-line

Jovanovic # 4	171 mm

Granulatstopfer
Granulate plugger
Fouloir à granulat

2500-39 F F-line

8-10-13-15-16-18	160 mm

Granulatstopfer, graduiert, nicht kalibriert
Granulate plugger, graduated, non-calibrated
Fouloir à granulat, graduation, non calibré

2500-40 F F-line

	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

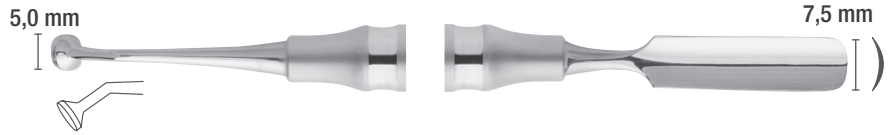

2500-35 F F-line

Biehler	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

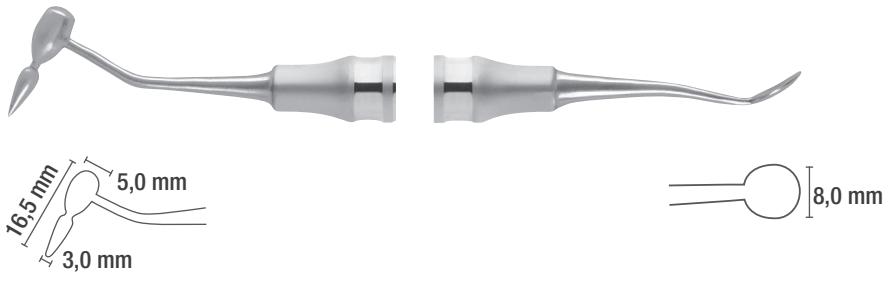

2500-41 F F-line

	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

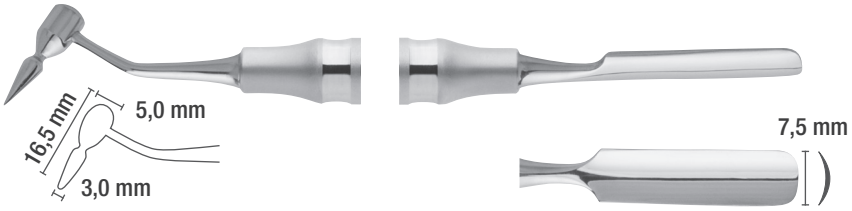

Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2500-42 F	F-line
Mazor	171 mm

Stopfer | Applikator
Compactor | Applicator
Compacteur | Applicateur

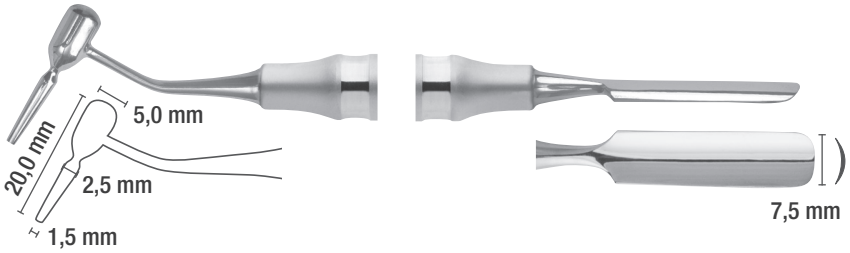

2500-43 F	F-line
	171 mm

Applikator, für 2500-44 F
Applicator, for art no 2500-44 F
Applicateur, pour 2500-44 F

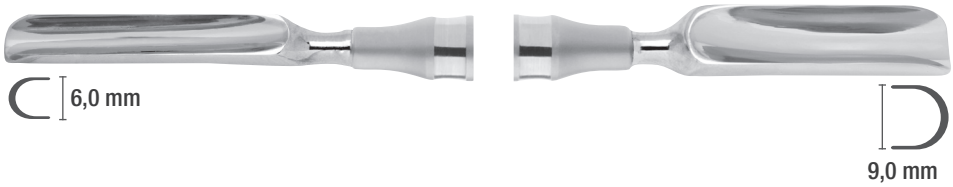

2500-44 F	F-line
	171 mm

Stopfer | Schieber für 2500-43 F
Plugger | Pusher for art no 2500-43 F
Compacteur | Bouchoir pour 2500-43 F

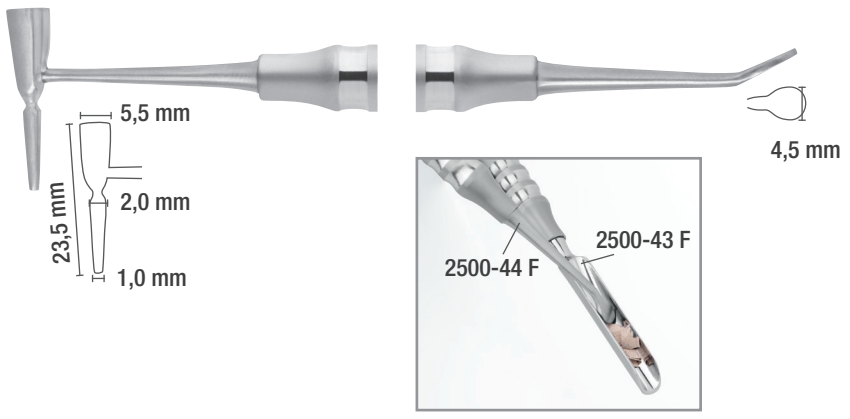

Gewebstransplantatstopfer, fein gezahnt | Granulatstopfer

Tissue graft plug, fine serrated | Granulate plugger

Compacteur pour tissu, denture fine | Fouloir à granulat

F-line SL

NEW

Mit dem Gewebstransplantatstopfer wird das Einbringen des Schleimhauttrasplantats oder der Membran vorgenommen. Der Granulatstopfer mit Zahnung kann verwendet werden, um Knochenmaterial zu verdichten.

The tissue graft plug is used to insert the mucosal graft or membrane. The granulate plugger with serration can be used to compact bone material.

Le compacteur pour tissu permet de mettre en place le greffon muqueux ou la membrane. Le fouloir à granulat avec denture peut être utilisé pour compacter le matériau osseux.

2500-48 F	F-line
Bernotti	171 mm

2500-45 F	F-line
	171 mm

Applikator
Applicator
Applicateur

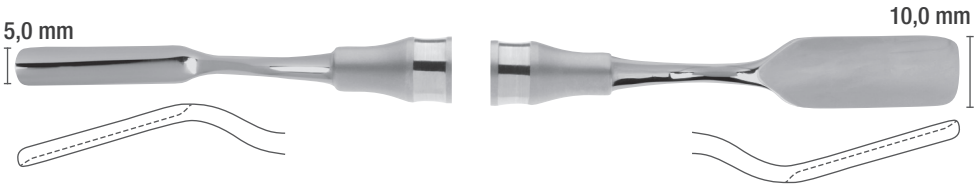

2400-40 F	F-line
Ivory	200 mm

Applikator
Applicator
Applicateur

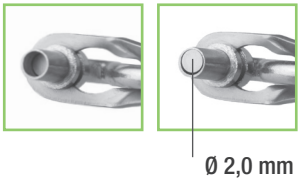

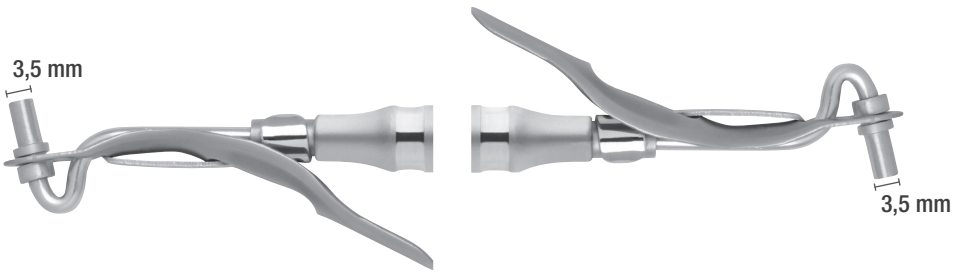

Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

F-line SL

2405-90	
	135 mm Ø 5,0 mm

Applikator
Applicator
Applicateur

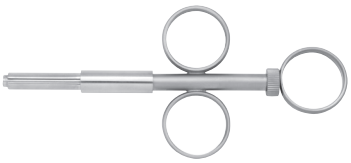

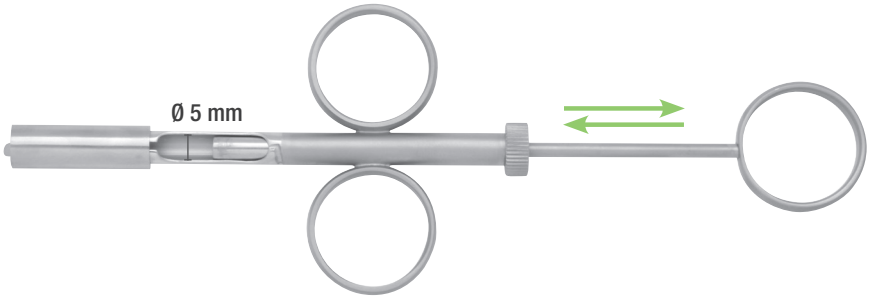

Augmentat einfüllen
fill in the augmentation material
remplisser l´augmentation osseuse

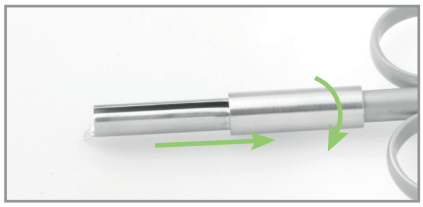

Applikator verschließen
close the applicator
refermer l´applicateur

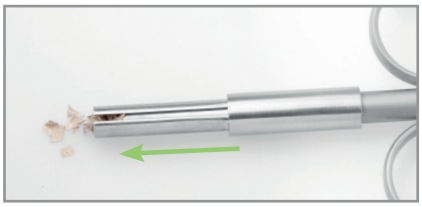

Augmentat dosieren
dispense the augmentation material
doser l´augmentation osseuse

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Länge Length Longueur	Ø	Spitze tip pointe
2405-1	170 mm	OD ID	3,5 mm 2,5 mm
2405-2		OD ID	4,5 mm 3,5 mm
2405-3		OD ID	5,5 mm 4,5 mm
2405-4		OD ID	7,0 mm 6,0 mm

Applikator
Applicator
Applicateur

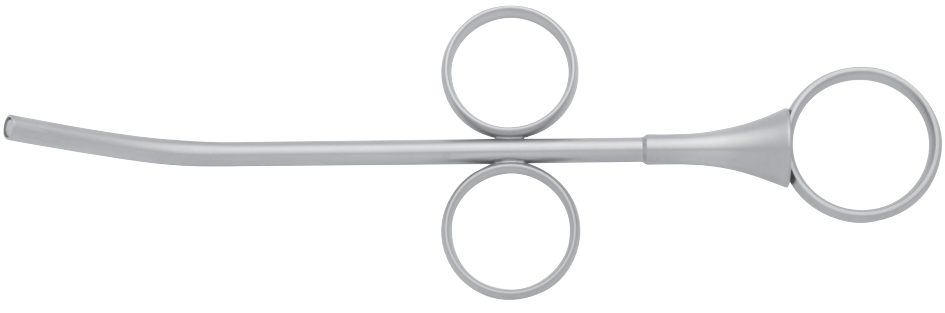

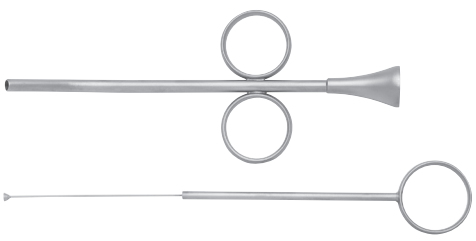

i

OD = outer diameter
ID = inner diameter

Knochenapplikation
Bone application
Instruments et applicateurs pour l´augmentation

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	
2500-29 F	OD ID	5,0 mm 4,0 mm
170 mm		

Applikator
Applicator
Applicateur



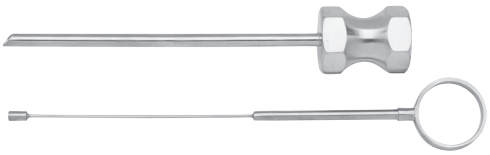

OD = outer diameter
ID = inner diameter

Art.-Nr. Item no. Art.-Réf.	Ø	Spitze tip pointe	Ende end bout
2409	OD ID	4,0 mm 3,0 mm	6,0 mm 5,0 mm
170 mm			

Absaugkanüle*
Aspiration cannula*
Canule d´aspiration*

inkl. 1 x Filter für Knochenspäne
incl. 1 x filter for collection of bone chips
incl. 1 x filtre pour os autogène

2409-1
Ø 9,0 mm

Ersatzfilter für Art.Nr. 2409
Replacement filter for Art.No. 2409
Filtre de remplacement pour Art.No. 2409

*ACHTUNG: Kein Medizinprodukt!
*ATTENTION: No medical device!
*ATTENTION: Pas de produit médical!

F-line SL

2500-81 F F-line
Buser 171 mm

Membran Platzierungsinstrument
Membrane positioning instrument
Instrument pour placement des membranes

SET | Absaugkanüle für Knochenspäne
SET | Bone aspirator
SET | Canule d´aspiration osseuse

F-line RS

Mit dem Absauger werden gezielt Knochenspäne und Zahngold eingezogen und im innenliegenden Filter aufgefangen. Das Material kann dort problemlos zur Augmentation entnommen werden.

This bone aspirator vacuums bone chips and dental gold and collects it in an internal filter. The material can be easily removed and used for augmentation.

Cette canule à aspiration osseuse sert à aspirer de manière précise les fragments osseux et l'or des dents qui sont rassemblés dans le filtre intérieur. Le matériau se laisse ensuite prélever facilement pour préparer l´augmentation osseuse.

Set: 2410-00

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 2410-00 Item no. of the set: 2410-00 Set complet réf.: 2410-00	
2410-05 F F-line	Absaugkanüle für Knochenspäne Bone aspirator Canule d´aspiration osseuse	220 mm, ohne Zubehör 220 mm, without accessories 220 mm, sans accessoires	
2410-10	Silikonfilter Silicone filter Filtre en silicone	Ø 20 mm, 30 mm	Packung mit 5 Stück Package with 5 units Paquet de 5 unités
2410-30	Absaugerspitze Suction cannula tip Tube d'aspiration	Ø 3 mm, 32 mm	mit Schlitz gegen Anhaften with a slit to prevent adhesion avec échancrure contre collage
2410-50	Absaugerspitze Suction cannula tip Tube d'aspiration	Ø 5 mm, 32 mm	mit Schlitz gegen Anhaften with a slit to prevent adhesion avec échancrure contre collage

ACHTUNG: Kein Medizinprodukt!
ATTENTION: No medical device!
ATTENTION: Pas de produit médical!

Absaugkanüle für Knochenspäne

Bone aspirator

Canule d´aspiration osseuse

F-line RS

Packung mit 5 Stück
Package with 5 units
Paquet de 5 unités

2410-05 F	F-line
Absaugkanüle Bone aspirator Canule d´aspiration	220 mm

2410-30	Ø 4 mm
2410-50	Ø 6 mm
Absaugerspitze Suction cannula Tube d'aspiration	31 mm

mit Schlitz gegen Anhaften
with a slit to prevent adhesion
avec échancrure contre collage

2410-10	
Silikonfilter, einweg Silicone filter, disposable Filtre en silicone à usage unique	Ø 20 mm 30 mm

für Art. Nr. 2410-05 F
for art. no. 2410-05 F
pour art. no 2410-05 F

ACHTUNG: Kein Medizinprodukt!
ATTENTION: No medical device!
ATTENTION: Pas de produit médical!

Mischdosen für Knochenmaterial
Mixing bowls for bone material
Cuvette de mélange pour matériau osseux

2550-60
28 mm Ø 60 mm 25 cc

F-line RS

Die massive Ausführung in Edelstahl verhindert ein Wegrutschen oder Umkippen während der Anwendung. Der Deckel verhindert das Austrocknen und Kontaminieren des gewonnenen Materials.

The solide stainless steel design prevents slipping and tilting during application. The lid avoids dehydration and contamination of extracted material.

La conception massive en acier inoxydable prévient tout glissement ou basculement au cours de l'utilisation. Le couvercle prévient le desséchement et la contamination du matériau prélevé.

2550-50 F F-line
20 mm Ø 38 mm max. 5 cc

massiv, mit Deckel
solid, with cover
solide, avec couvercle

Füllhöhe 14,5 mm
Fill level 14,5 mm
Hauteur de remplissage 14,5 mm

Knochenmühle
Bone mill
Broyeur d'os

für die Gewinnung von autologem Knochen
for the recovery of autogenous bone
pour la préparation de l'os autogène

2550-3
170 mm Ø 16 mm

mit Titan Zahnung
with titanium cutting surfaces
avec dents en titane

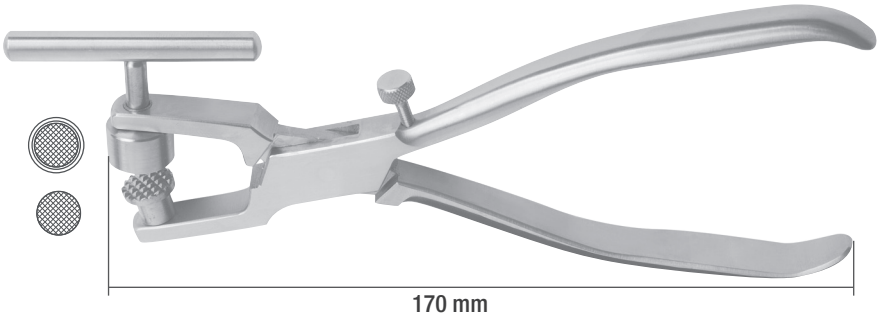

Knochenquetsche
Bone Crusher
Presse d'os

F-line RS

Diese neu entwickelte Knochenquetsche vereint Knochenmühle und Mischdose. Der Knochen wird mit Hilfe des Zylinders und eines Hammers in der kleinen Öffnung zermahlen, in die große Öffnung übertragen und dort mit Blut oder Knochenersatzmaterial angerührt.

- kein Verlust von Knochenmaterial
- einfache Anwendung
- leichte Reinigung
- massiver Korpus verhindert Rutschen
- Knochemühle und Mischdose in einem
- durch 2 Löcher ist die Menge variabel

www.devemed.de/de-DE/download-service/videos

This newly developed bone crusher combines a bone mill and a mixing vessel. The bone is ground up in the small opening with the aid of the cylinder and a hammer, then transferred to the large opening where it is mixed with blood or bone substitute material.

- no loss of bone material
- simple to use
- easy to clean
- massive corpus prevents slipping
- bone mill and mixing vessel in one
- the amount is variable due to 2 holes

www.devemed.de/en-US/download-service/videos

Cette nouvelle presse d'os réunit un broyeur d'os et une boîte de mélange. L'os est broyé à l'aide du cylindre et d'un marteau dans le petit orifice avant d'être transféré dans le grand orifice et d'y être mélangé avec du sang ou du substitut osseux.

- Aucune perte de tissu osseux
- Application aisée
- Nettoyage facile
- Un corps massif qui prévient tout glissement
- Broyeur d'os et boîte de mélange tout-en-un
- Quantité variable grâce aux 2 trous

www.devemed.de/en-US/download-service/videos

2550-00 F	F-line
	Ø 90 mm

zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial
for winning autologous bone material
pour gagner le matérial d'os autologène

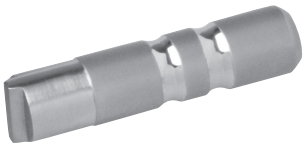

Schleimhautstanzen – Zirkuliermesser
Mucosa punches – circular knives
Tréphines à gencives – couteaux circulaires

2403-117	2403-130	2403-140	2403-150	2403-160
23 mm Ø 1,7 mm	23 mm Ø 3 mm	23 mm Ø 4 mm	23 mm Ø 5 mm	23 mm Ø 6 mm

Die Schleimhautstanzen sind für alle gängigen Winkelstücke geeignet.
These mucosa punches are appropriate for all angular pieces.
Toutes ces tréphines conviennent aux embouts courants.

2405-601

Bohrerständer für Schleimhautstanzen bis zu einer Länge von 35 mm
Rack for mucoas punches up to a length of 35 mm
Séquenceur pour tréphines à gencives jusqu´à longueur de 35 mm

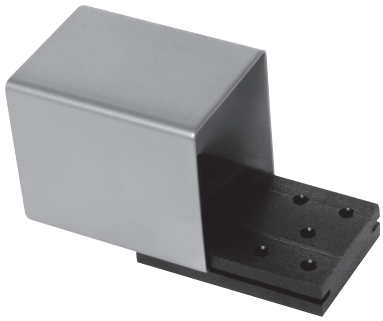

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

Trepanfräsen
Trephine burrs
Trépans

2401-120
I = 2 mm, A = 3 mm

2401-130
I = 3 mm, A = 4 mm

2401-140
I = 4 mm, A = 5 mm

2401-150
I = 5 mm, A = 6 mm

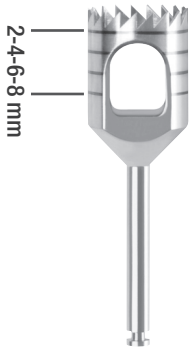

2401-160
I = 6 mm, A = 7 mm

2401-170
I = 7 mm, A = 8 mm

2401-180
I = 8 mm, A = 9 mm

2401-190
I = 9 mm, A = 10 mm

I = Innendurchmesser
I = Internal diameter
I = diamètre intérieur

A = Aussendurchmesser
A = External diameter
A = diamètre extérieur

Die Trepanfräsen sind für alle gängigen Winkelstücke geeignet.
These trephine burrs are appropriate for all angular pieces.
Tous ces trépans conviennent aux embouts courants.

10900-10

Trepanfräsen Set mit Bohrerständer
Set of trephine burrs with rack
Set Trépans avec séquenceur

bestehend aus: 2401-120 bis 2405-601
consisting of: 2401-120 to 2405-601
consiste de: 2401-120 à 2405-601

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

AUGMENTATION SET – ALL IN ONE

BONE-GRAFTING SET – ALL IN ONE
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE

Set: 10100-49

Für die Setzung des Implantats im Kiefer muss genügend Knochenangebot zur Verfügung stehen. Sollte dieses nicht ausreichend vorhanden sein, muss zusätzlich ein Knochenaufbau (Augmentation) durchgeführt werden.

Dieses zusammengestellte Set ermöglicht alle fünf dargestellten Augmentationstechniken auszuführen. (siehe nächste Seite)

To be able to insert the impant into the maxilla, enough jaw bone must be available. If that is not the case, an additional bone augmentation is indispensable.

This compiled Set allows to perform each of the five augmentation techniques shown on the next page.

Afin de pouvoir placer un implant, il est important d´avoir un volume osseux suffisant. Si ce volume osseux est insuffisant, il est conseillé de faire une augmentation.

Notre Set spécialement conçu permet d´effectuer les cinq techniques d´augmentation présentées (voir page suivante).

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-49 Item no. of the set: 10100-49 Set complet réf.: 10100-49
2501-90 F F-line	Flachmeißel, gerade, graduiert Bone chisel, straight, graduated Ciseau-burin à os, droit, gradué	171 mm, 4,0 mm
2501-92 F F-line	Flachmeißel, gerade, graduiert Bone chisel, straight, graduated Ciseau-burin à os, droit, gradué	171 mm, 8,0 mm
2501-95 F F-line	Flachmeißel, gebogen, graduiert Bone chisel, curved, graduated Ciseau-burin à os, courbé, gradué	171 mm, 4,0 mm
2501-97 F F-line	Flachmeißel, gebogen, graduiert Bone chisel, curved, graduated Ciseau-burin à os, courbé, gradué	171 mm, 8,0 mm
2811-00 (2x)	Handgriff „Palti“ Handle „Palti“ Manche „Palti“	für Osteotom- & Bone Pusher Aufsatz for osteotome- & bone pusher attachment pour embouts d´ostéotomes et fouloirs à os
860-50 F F-line	Hammer, 170 mm, 180 g, „Vickers“ Mallet, 170 mm, 180 g, „Vickers“ Maillet, 170 mm, 180 g, „Vickers“	Hohlgriff hollow handle poignée creuse
921-11 F F-line	Sinus Kürette # 2 „Palti“ Sinus curette # 2 „Palti“ Sinus curette # 2 „Palti“	170 mm, 3,5 I 3,5 mm
923-60 F F-line	Sinus Kürette „Tatum/Palti“ Sinus curette „Tatum/Palti“ Sinus curette „Tatum/Palti“	150 mm, 3,0 I 3,0 mm

AUGMENTATION SET – ALL IN ONE bestehend aus:

BONE-GRAFTING SET – ALL IN ONE consisting of:
AUGMENTATION SET – ALL IN ONE consiste de:

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-49 Item no. of the set: 10100-49 Set complet ref. 10100-49
2500-31 F	Stopfer I Applikator Compactor I Applicator Compacteur I Applicateur	für Knochenmaterial, 171 mm for bone grafting material, 171 mm pour matériau à os, 171 mm
2550-60	Mischdose für Knochenmaterial Mixing bowl for bone material Cuvette de mélange pour mat. osseux	25cc
2816-27	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 2,7 mm bayonet, 2,7 mm baïonnette, 2,7 mm
2816-32	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 3,2 mm bayonet, 3,2 mm baïonnette, 3,2 mm
2816-37	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 3,7 mm bayonet, 3,7 mm baïonnette, 3,7 mm
2816-42	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 4,2 mm bayonet, 4,2 mm baïonnette, 4,2 mm
2816-50	Bone Pusher-Aufsatz „Palti“ Bone pusher attachment „Palti“ Embout fouloir-os, „Palti“	bajonett, 5,0 mm bayonet, 5,0 mm baïonnette, 5,0 mm
2824-20	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 1,5 < 2,0 mm bayonet, convex; 1,5 < 2,0 mm baïonnette, convexe; 1,5 < 2,0 mm
2824-27	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 2,0 < 2,7 mm bayonet, convex; 2,0 < 2,7 mm baïonnette, convexe; 2,0 < 2,7 mm
2824-32	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 2,7 < 3,2 mm bayonet, convex; 2,7 < 3,2 mm baïonnette, convexe; 2,7 < 3,2 mm
2824-37	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 3,2 < 3,7 mm bayonet, convex; 3,2 < 3,7 mm baïonnette, convexe; 3,2 < 3,7 mm
2824-42	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 3,7 < 4,2 mm bayonet, convex; 3,7 < 4,2 mm baïonnette, convexe; 3,7 < 4,2 mm
2824-50	Osteotom-Aufsatz „Palti“ Osteotome attachment „Palti“ Embout ostéotome „Palti“	bajonett, konvex; 4,2 < 5,0 mm bayonet, convex; 4,2 < 5,0 mm baïonnette, convexe; 4,2 < 5,0 mm
2409	Absaugkanüle für Knochenspäne Bone aspirator for collection of bone chips Canule d´aspiration pour os autogène	170 mm, inkl. Filter Ø 9 mm 170 mm, I, incl. filter Ø 9 mm 170 mm, incl. filtre Ø 9 mm
2500-01 F	Knochenringhaltezange „Palti“ Bone ring holding forceps „Palti“ Pince pour tenir les anneaux osseux Palti“	
10900-10	Trepanfräsen Set Trephine burrs Set Set de trépans	Ø 2,0 I 3,0 I 4,0 I 5,0 I 6,0 I 7,0 I 8,0 I 9,0 mm
9100-15	GPM Wash Tray (275 x 180 x 35 mm)	mit Deckel I mit Haltegriff with cover I with handle avec couvercle I avec poignée

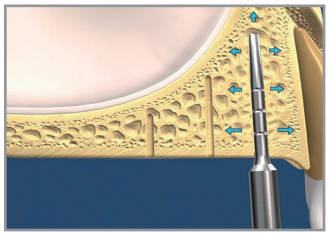

Bone Condensing

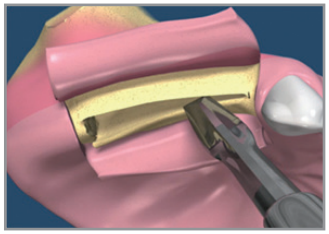

Ridge Splitting

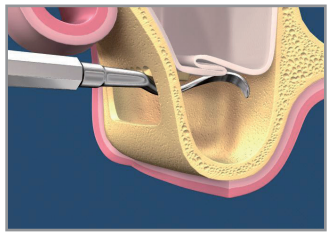

Lateraler Sinus-Lift
Lateral Sinus-Lift
Sinus-Lift latéral

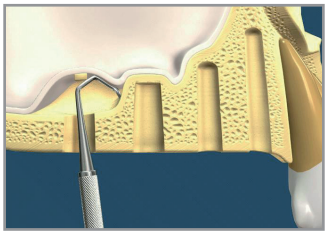

Interner Sinus-Lift
Internal Sinus-Lift
Sinus-Lift interne

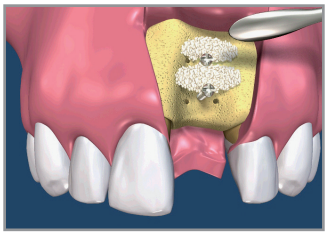

Knochenblock
Bone block
Bloc osseux

Images provided by Consult-PRO™ Dental Patient Education Software www.consult-pro.com

Knochenringhaltezange
Bone Ring holding forceps
Pince pour tenir les anneaux osseux

Die Knochenringhaltezange verfügt über ein sehr feines Gewinde. Es dient für eine optimale Einstellung bei der Fixierung des Knochenblocks. Des Weiteren ermöglicht die Haltezange eine optimale Stabilisierung und exakte Bearbeitung des Knochens und vermindert das Risiko von Frakturierungen.

These bone ring holding forceps have a very fine thread, which enables optimal adjustment when setting the bone block. Furthermore these forceps allow the optimal stabilization and precise treatment of the bone. It also serves to minimize fracturing.

Cette pince dispose d´un filetage fin qui sert au réglage précis et à la fixation parfaite du bloc osseux. Elle permet aussi une stabilisation parfaite ainsi que le traitement exacte du bloc osseux et réduit ainsi les risques de fracture.

2500-01 F	F-line
Palti	125 mm

Knochenhaltezangen / Gewebefasszangen
Bone holding forceps / Tissue grasping forceps
Pinces pour tenir les anneaux osseux / Pinces de préhension des tissus

Diese Knochenhaltezange eignet sich besonders zur Fixierung eines Knochenblocks am Kieferdefekt. Ohne Umgreifen kann der Knochen vorgebohrt und zum Festschrauben an den Defekt gehalten werden. Die Zahnung an der Spitze gibt dem Knochenblock zusätzlichen Halt.

These bone holding forceps is especially suitable for fixing a bone block on the jaw defect. The bone can be predrilled and held for screwing firmly onto the defect without changing grip. The serration on the tip gives the bone block extra hold.

Cette pince a été spécialement conçue pour la fixation d´un bloc osseux à un défaut de la mâchoire. Sans bouger la main, l´os peut être pré- percé pour être ensuite tenu et visser au défaut. La denture à l´extrémité assure un maintien supplémentaire au bloc osseux.

2500-03	
	175 mm
gebogen curved courbé	

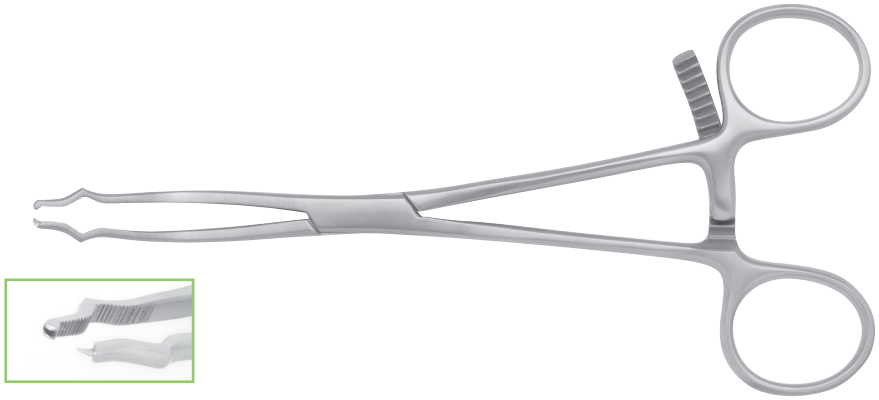

1030-1	
Allis	160 mm
gerade straight droit	

1030-2	
Allis	150 mm
30°	

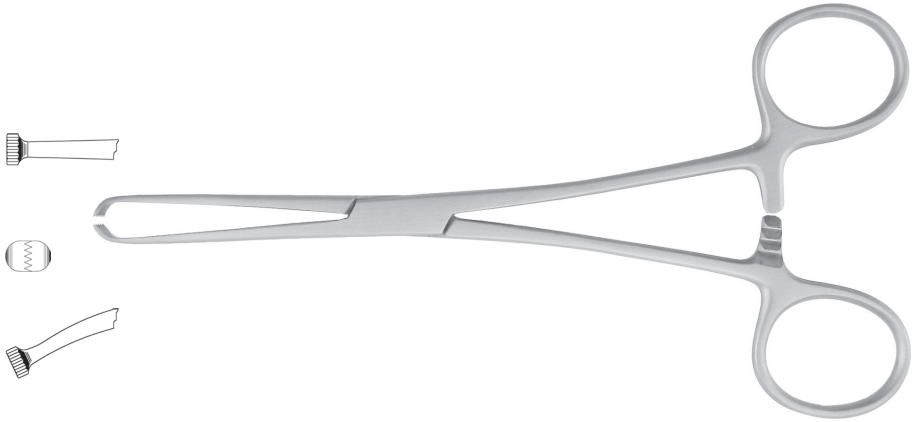

Fasspinzette für Knochenringe
Fixation tweezers for bone rings
Précelle pour bague osseuse

F-line RS

Die Fasspinzette ergreift sicher den Knochenring und ermöglicht somit eine präzise Bearbeitung und einfache Platzierung.

The fixation forceps ensure secure gripping of the bone ring and thus enable meticulous processing and placement.

La précelle garantit une préhension sûre de la bague osseuse et permet ainsi un traitement et un positionnement soigneux.

NEW

2230-80 F	F-line
Lorean	171 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre



Kieferhöhlensonde
Antrum probes
Sondes pour le sinus maxillaire

F-line SL

NEW

2407-50 F	F-line
	165 mm

2407-30	
	130 mm

NEW

Tiefenmessgeräte
Depth gauges
Jauge de profondeur

F-line SL

Die Tiefenmesser ermöglichen eine genaue Messung der Implantatkavität.

Es können die anatomischen Nachbarstrukturen sowie die Integrität der Kavität optimal geprüft werden. Auch das vertikale und horizontale Knochenangebot des Patienten kann mit diesen Instrumenten intraoperativ exakt gemessen werden.

These depth gauges allow to accurately measure the depth of the implant cavity.

The neighbouring anatomical structures and the integrity of the cavity can optimally be checked. The horizontal and vertical bone volume can also be precisely measured intraoperatively.

Ces instrument permets de mesurer avec précision la profondeur de la cavité.

La jauge permet de sonder l´intégrité de la cavité et des structures adjacentes anatomiques. Même pendant l´intervention la sonde peut mesurer avec exactitude la présence osseuse à l´horizontal et à la verticale.

2406-90 F	F-line
Palti	171 mm
8-10-12-14-16-18	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré

2406-91 F	F-line
Mazor # 7	171 mm
8-10-13-15	

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradué, non calibré

Das Tiefenmessgerät nach Dr. Simas kann durch seine sehr feine Spitze in das Zahnfleisch eingeführt werden und ermöglicht mit Hilfe der Markierung ein genaues Messen der Zahnfleischdicke.

The depth gauge according to Dr. Simas can be introduced into the gum via its very fine tip, enabling a precise measurement of the gum thickness with the help of the marking.

La jauge de profondeur du Dr. Simas se laisse facilement introduire dans la gencive grâce à son extrémité très pointue. Le marquage à l´extrémité permet de mesurer exactement la présence osseuse.

NEW

2406-92 F	F-line
Simas	163 mm
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	

spitz, graduiert, nicht kalibriert
pointed, graduated, non-calibrated
pointu, gradué, non calibré

speziell für Weichgewebe
especially for soft tissue
spécialement pour tissus mous

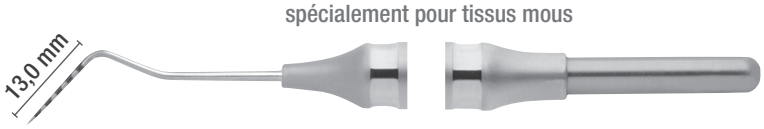

Messinstrumente
Measuring instruments
Instruments de mesure

2406-50	
	125 mm 0 - 100 mm

Mini Messlehre, nicht kalibriert
Mini sliding caliper, non-calibrated
Mini-jauge gradué, non calibré

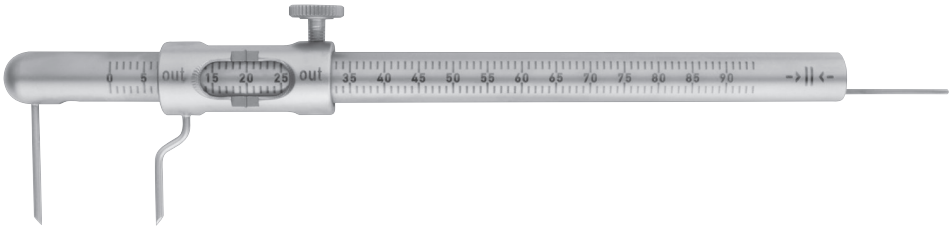

0 - 15 mm	0 - 20 mm	0 - 40 mm	
2406-10	**2406-11**	**2406-12**	gerade straight droit
	2406-21	**2406-22**	abgewinkelt angled coudé
	2406-41	**2406-42**	gebogen curved courbé
Castroviejo			90 mm

Messzirkel, nicht kalibriert
Caliper, non-calibrated
Compas de mesure, non calibré

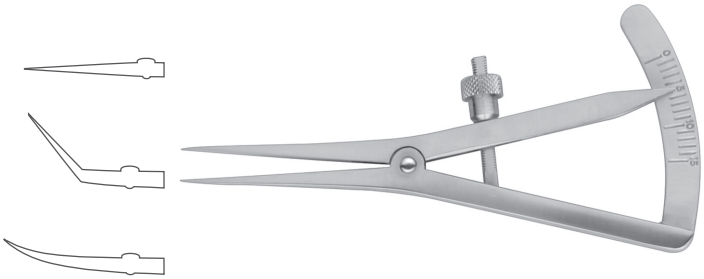

2406-30	
Castroviejo	90 mm 0 - 20 mm

Messzirkel, nicht kalibriert
Caliper, non-calibrated
Compas de mesure, non calibré

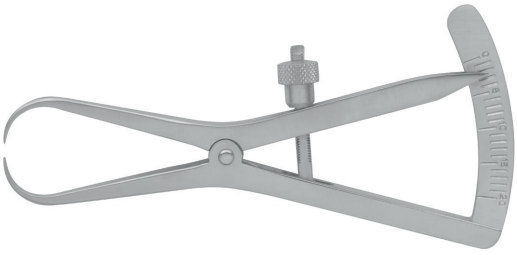

für Dental-Implantate
for dental implants
pour implant-dentaire implants

Lineal
Ruler
Reglet

2406-70	
	218 mm

Millimeter und Zoll, nicht kalibriert
millimeter and inches, non-calibrated
millimètre et pouce, non calibré

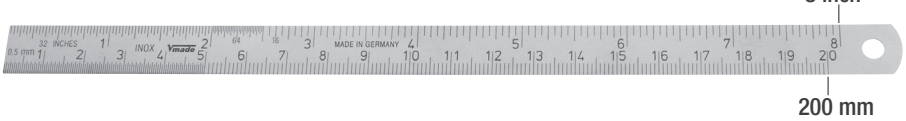

2-in-1 | Mikro-Schrauben und Pins in einer Toolbox
2-in-1 | Micro screws and Pins in one Toolbox
2-in-1 | Micro-vis et Micro-Pins dans une Toolbox

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | QUADRO TITAN Mikro-Schrauben
dev-os | QUADRO TITANIUM Micro screws
dev-os | QUADRO TITANE Micro-vis

Farbmarkierung
Colour coding
Code de couleurs

Ø 1,0 mm dev-os-system	
Ø 1,3 mm dev-os-system	
Ø 1,5 mm dev-os-system	
Ø 1,8 mm dev-os-system	

Der Schraubenkopf mit dem leicht konischen Quadro-Profil verhindert ein Durchdrehen der Schraube und sorgt für einen besseren Halt am Schraubendreher. So ist ein sicheres Aufnehmen und Platzieren gewährleistet.

The screw head with the slightly conical Quadro-Profile prevents the screw from spinning and enables better purchase on the screwdriver. This ensures secure insertion and placement.

La tête de vis avec son profil Quadro légèrement conique, empêche un glissement de la vis et permet une meilleure tenue au tournevis. Cela assure un saisissement et placement de la vis en toute sécurité.

	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm	15 mm
Ø 1,0 mm	4010-05	4010-07	4010-09			
Ø 1,3 mm	4013-05	4013-07	4013-09	4013-11	4013-13	4013-15
Ø 1,5 mm	4015-05	4015-07	4015-09	4015-11	4015-13	4015-15
Ø 1,8 mm	4018-05	4018-07	4018-09	4018-11	4018-13	4018-15

Packung mit 5 Stück
Package of 5 pieces
Paquet de 5 pièces

QUADRO

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | QUADRO Schraubendreherklingen
dev-os | QUADRO Screwdriver blades
dev-os | QUADRO Lames pour le tournevis



Schraubendreherklingen sind in zwei Längen erhältlich. Das QUADRO-Profil verhindert ein Durchdrehen der Schraube und sorgt für einen besseren Halt. Für die Schraubensysteme 1,3 mm, 1,5 mm und 1,8 mm ist nur eine Klinge notwendig (schwarz).

Screwdriver blades are available in two lengths. The QUADRO-Profile prevents the screw from spinning and en-ables better purchase. Only one blade (black) is required for the 1.3 mm, 1.5 mm and 1.8 mm screw systems.

Les lames pour le tournevis sont disponibles dans deux longueurs différentes. Le profil QUADRO empêche un glissement de la vis et permet une meilleure tenue. Pour les lames de tournevis 1,3 mm, 1,5mm et 1,8mm, une seule lame est nécessaire (noire)

dev-os-system	70 mm	30 mm
Ø 1,0 mm	4210-20	4210-21
Ø 1,3 mm	4213-20	4213-21
Ø 1,5 mm		
Ø 1,8 mm		

mit Dentalansatz
with dental fitting
avec embout dentaire



mit Farbmarkierung
with colour coding
Avec code de couleurs



dev-os | Pilotbohrer
dev-os | Pilotdrills
dev-os | Forets



Ø 1,0 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 0,7 mm Ø Pilotdrill 0,7 mm Ø Foret 0,7 mm		4210-00
Ø 1,3 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,0 mm Ø Pilotdrill 1,0 mm Ø Foret 1,0 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4213-00
Ø 1,5 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,2 mm Ø Pilotdrill 1,2 mm Ø Foret 1,2 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4215-00
Ø 1,8 mm dev-os-system	Ø Pilotbohrer 1,5 mm Ø Pilotdrill 1,5 mm Ø Foret 1,5 mm	graduiert 5-7-9-11-13 mm graduated 5-7-9-11-13 mm graduée 5-7-9-11-13 mm	4218-00

15 mm Stop, mit Dentalansatz
15 mm Stop, with dental fitting
15 mm Stop, avec embout dentaire

graduiert 5-7-9-11-13 mm
graduated 5-7-9-11-13 mm
graduée 5-7-9-11-13 mm

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-os | Handdrehgriff
dev-os | Turning handle
dev-os | Poignée pour tournevis



- passend für
  - Schraubendreherklingen
  - Pin-Applikator
  - Pin-Dreher
- komfortables Handling
- Druckpunkt hinten ist fest, Silikon Griff drehbar
  > vereinfachtes Festdrehen und Lösen von Schrauben und Pins

Den Druckpunkt an der Handfläche anlegen und den Silikongriff mit den Fingern drehen. So gelingt ein einfaches und sicheres Drehen in der Hand.

- Suitable for
  - Screwdriver blades
  - Pin applicator
  - Pin driver
- Convenient handling
- Fixed pressure point at the rear, silicone handle can be rotated
  > Simplified tightening and loosening of screws and pins

Place the pressure point against the palm of your hand and turn the silicone handle using your fingers. This en-ables simple and reliable turning by hand.

- adaptable pour
  - Lames pour le tournevis
  - Pin-Applicateur
  - Tournevis pour pins
- maniement confortable
- point de pression fix à l'arrière de la poignée silicone et tournante
  > simple serrage et desserrage des vis et pins

Placer le point de pression dans la main et tourner la poignée silicone. Comme ça, la rotation est faisable sûre et facilement.

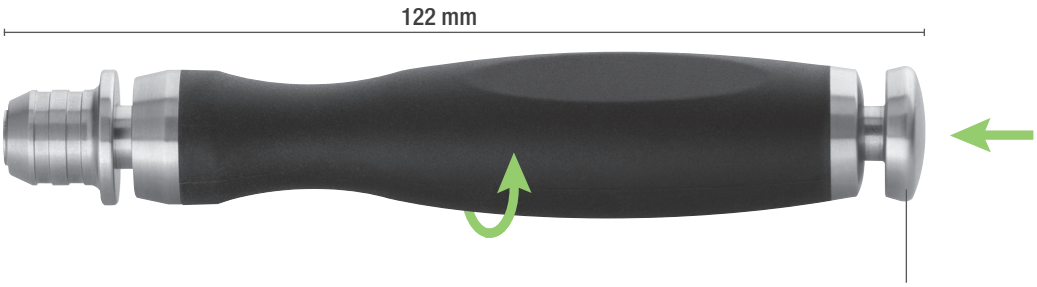

Ø 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 mm dev-os-system	4311-00

Silikon, mit Dentalansatz, drehbar
Silicon, with dental fitting, turnable
Silicone, avec embout dentaire, tournante

„Druckpunkt“
„Pressure point“
„point de pression“

dev-pin | TITAN Pins
dev-pin | TITANIUM Pins
dev-pin | TITANE Pins

Mit den TITAN Pins werden Titanfolien und Membrane fixiert. Pins mit HEX HEAD-Kopf können auf Grund des Gewindes nach der Heilung problemlos mit dem Pin-Dreher entfernt werden.

The TITANIUM pins are used to secure titanium meshs and membranes. HEX HEAD pins can be easily removed after healing using the pin driver due to the thread.

Les Pins en titane servent à fixer les feuilles de titane et membranes. Pins avec tête HEX HEAD peuvent être facilement retirés à cause de filetage après la guérison à l´aide du tournevis pour pins.

	HEX HEAD	Länge Length Longueur
4901-03	4901-13	3,0 mm
4901-05	4901-15	5,0 mm
Packung mit 15 Stk. Package of 15 pcs Paquet de 15 pièces	Packung mit 10 Stk. Package of 10 pcs Paquet de 10 pièces	

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-pin | Pin-Applikator
dev-pin | Pin-Applicator
dev-pin | Pin-Applicateur



Der Applikator ermöglicht ein bequemes Aufnehmen der Pins aus der Tool-Box und ein direktes Anbringen am Kiefer. Mit seinem Dentalansatz ist der Applikator passend für den dev-os Handdrehgriff.

The applicator facilitates convenient insertion of the pins from the toolbox and direct application in the jaw. With its dental attachment, the applicator is suitable for the dev-os manual turning handle.

L´applicateur permet une prise confortable des pins de la Tool-Box et un placement direct à la mâchoire. Avec son embout dentaire, l´applicateur est approprié au poignée dev-os.

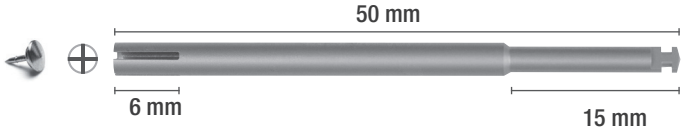

4902-20

Titanium Endstück, gerade
Titanium endpiece, straight
Titanium bloc d'extrémité, droite

mit Dentalansatz, passend für 4311-00
with dental fitting, suitable for 4311-00
avec embout dentaire, adapté aux 4311-00

dev-pin | HEX-HEAD Pin-Dreher
dev-pin | HEX-HEAD Pin-Driver
dev-pin | HEX-HEAD Tournevis pour pins



Mit dem Dreher lassen sich die im Kiefer angebrachten HEX HEAD-Pins nach der Heilung schnell und einfach entfernen.

The driver allows the HEX HEAD pins inserted in the jaw to be quickly and easily removed after healing.

Le tournevis pour pins permet de retirer les pins HEX HEAD placés dans la mâchoire, après la guérison, de manière simple et rapide.

4902-55

Titanium Endstück, gerade
Titanium endpiece, straight
Titanium bloc d'extrémité, droite

mit Dentalansatz, passend für 4311-00
with dental fitting, suitable for 4311-00
avec embout dentaire, adapté aux 4311-00





für die Entnahme von Pins (Art Nr. 4901-13 & 4901-15)
for removing pins (art no. 4901-13 & 4901-15)
pour le prélèvement de pins (art no. 4901-13 & 4901-15)

dev-os | Toolbox
dev-os | Toolbox
dev-os | Toolbox

- übersichtliche Aufteilung (schnelle Zuordnung)
- individuell bestückbar
- zur Aufbewahrung von:
  - Handgriff
  - Schrauben, in vier unterschiedlichen Durchmessern und bis zu sechs Längen
  - Pins, in zwei verschiedenen Längen
  - verschiedene Bohrer
  - Schraubendreherklingen (kurz/lang)
  - Pin-Applikator
  - Pin-Dreher
- einfache, direkte Aufnahme von Schrauben und Pins möglich
- Messskala zum Nachmessen von Schrauben, Pins und Bohrer (nicht kalibriert)

- Clear arrangement (quick correlation)
- Individually configurable
- for storage of:
  - Handle
  - Screws, in four different diameters and up to six lengths
  - Pins, in two different lengths
  - Various drills
  - Screwdriver blades (short/long)
  - Pin applicator
  - Pin driver
- Supports simple, direct storage of screws and pins
- Measurement guide for measuring screws, pins and drills (non-calibrated)

- présentation claire (visualisation rapide)
- équipement individuel
- pour le stockage de:
  - poignée
  - vis, disponibles dans quatres diamètres et six longeurs différents
  - Pins, disponibles dans deux longeurs différents
  - différents forets
  - lame pour le tournevis (court/long)
  - pin-applicateur
  - tournevis pour pins
- un saisissement simple et direct de vis et pins
- échelle de mesure pour mesurer les vis, pins et forets (non calibré)

4400-00

Aluminium, leer
Aluminium, empty
Aluminium, vide

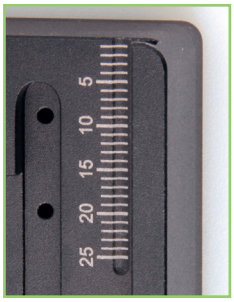

9
11
13
15
Ø 1.3 mm
5 mm
3 mm

Pinbox mit Zubehör
Pins with accessories
Pinbox avec accessoires

dev-pin | TITAN Pins
dev-pin | TITANIUM Pins
dev-pin | TITANE Pins

Mit den TITAN Pins werden Titanfolien und Membrane fixiert. Pins mit HEX HEAD-Kopf können auf Grund des Gewindes nach der Heilung problemlos mit dem Pin-Dreher entfernt werden.

The TITANIUM pins are used to secure titanium meshs and membranes. HEX HEAD pins can be easily removed after healing using the pin driver due to the thread.

Les Pins en titane servent à fixer les feuilles de titane et membranes. Pins avec tête HEX HEAD peuvent être facilement retirés à cause de filetage après la guérison à l´aide du tournevis pour pins.

	HEX HEAD	Länge Length Longueur
4901-03	4901-13	3,0 mm
4901-05	4901-15	5,0 mm
Packung mit 15 Stk. Package of 15 pcs Paquet de 15 pièces	Packung mit 10 Stk. Package of 10 pcs Paquet de 10 pièces	

ACHTUNG: Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!
ATTENTION: For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!
ATTENTION: Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

dev-pin | TITAN HEX HEAD Pin-Dreher
dev-pin | TITANIUM HEX HEAD Pin-Driver
dev-pin | TITANE HEX HEAD-Tournevis pour pins

Mit dem Titan Pin-Dreher lassen sich die im Kiefer angebrachten HEX HEAD-Pins nach der Heilung schnell und einfach mit der Hand entfernen.

The titanium pin driver allows the HEX HEAD pins inserted in the jaw to be quickly and easily removed by hand after healing.

Avec le tournevis pour pins, les pins HEX HEAD fixés dans la mâchoire, après la guérison, se laissent rapidement et facilement retirés à la main.

4902-50

für die Entnahme von Pins Art No. 4901-13 & 4901-15
for removing pin art no. 4901-13 & 4901-15
pour le prélèvement de pins art no. 4901-13 & 4901-15

dev-pin | Pin Box
dev-pin | Pin Box
dev-pin | Pin Box

Die Pin-Box lässt sich einfach mit einer Hand öffnen und bietet Platz für 15 Pins. Durch die Beschichtung ist die Box besonders robust und kratzresistent.

The pin box can be easily opened with one hand and can accommodate 15 pins. The coating makes the box particularly robust and scratch-resistant.

La boîte en TITANE pour les Pins s´ouvre facilement avec une main et offre d'espace pour 15 pins. Grâce au revêtement, la boîte est particulièrement robuste et résistante aux rayures.

4903-00 FBC

Ø 47 mm

dev-pin | Pin-Applikator; TITAN Endstück

dev-pin | Pin-Applicator; TITANIUM endpiece
dev-pin | Pin-Applicateur; TITANE Embout

Der Applikator ermöglicht ein bequemes Aufnehmen der Pins aus der Box und direktes Anbringen am Kiefer. Die zwei Ausführungen, gerade und gebogen, werden durch das Gewinde auf den Handgriff aufgedreht und können so, je nach Bedarf, einfach ausgetauscht werden

The applicator facilitates convenient insertion of the pins from the box and direct application in the jaw. The two designs, straight and curved, are screwed onto the handle via the thread allowing them to be easily switched as required.

L´applicateur permet une prise confortable des pins de la Pin Box et le placement direct à la mâchoire. Les deux modèles droit et courbé, se laissent facilement montés sur la poignée et peuvent être échangés selon besoin.

gerade straight droit	gebogen curved courbé
4902-10	**4902-15**

mit Schutzkappe, passend für 4902-00 F
with protecting cap, suitable for 4902-00 F
avec bout renforcé, adapté aux 4902-00 F

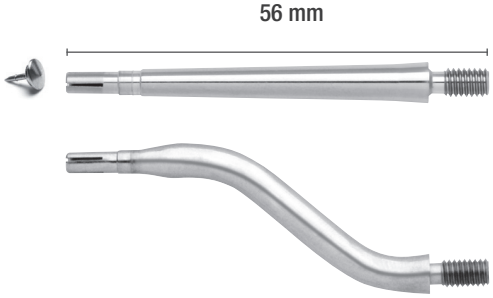

dev-pin | Handgriff für Pin-Applikator

dev-pin | Handle for Pin-Applicator
dev-pin | Manche pour Pin-Applicateur

F-line RS

Der *ROUND SOLID* Handgriff für die Titan Endstücke bietet besonders guten Halt bei Zug- und Druckbewegungen und eine direkte Kraftübertragung auf den Pin. Er liegt komfortabel in der Hand und ist einfach zu reinigen.

The *ROUND SOLID* handle for the titanium endpieces offers particularly good purchase in the case of tension and pressure movements, as well as direct transfer of force to the pin. It is comfortable to hold and easy to clean.

La manche *ROUND SOLID* pour les Pin-Applicateurs en TITANE offre un bon maintien en pression et traction et permet une transmission de force directement sur le pin. Elle se tient agréablement en main et est facile à nettoyer.

4902-00 F F-line
133 mm

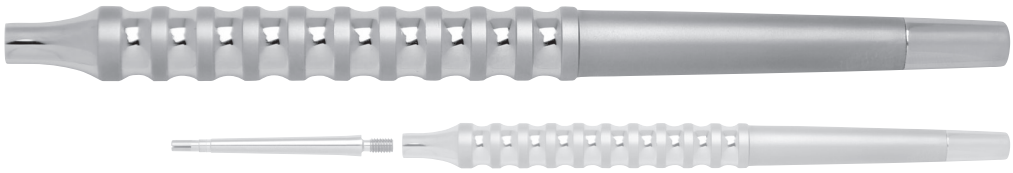

Pin Entferner | dev-pin-system
Pin-Remover | dev-pin-system
Pin enlever | dev-pin-system

F-line SL

Zur einfachen Entfernung der Pins aus dem Kieferkamm.

For easy removal of pins from the alveolar ridge.

Destiné au retrait de tenons de la crête osseuse en toute facilité.

4902-70 F F-line

165 mm

Pin Körner | dev-pin-system
Center-punch for pins | dev-pin-system
Pin-Pointeau | dev-pin-system

F-line RS

Mit dem sehr spitzen Arbeitsende können in der Membran Löcher für Pins vorgestochen werden.

The sharp pointed working end can be used to punch holes for pins into the membrane.

L'extrémité particulièrement pointue permet de pratiquer des pré-trous pour les tenons dans la membrane.

4902-80 F F-line

170 mm

Führungspinzette für Schraubendreher
Holding forceps for screw drivers
Précelle de guidage pour tournevis

F-line RS

Die Führungspinzette ermöglicht die Arbeit mit allen Schraubendrehern der gängigen Implantatsysteme. Die Abutments lassen sich durch den Einsatz der Führungspinzette einfacher Austauschen.

These holding forceps enable you to work with all major implant system screwdrivers. The abutments can be easily replaced when working with the holding forceps.

Cette précelle de guidage permet une manipulation aisée des différents tournevis et facilite la mise en place des composants prothétiques des systèmes implantaires.

2230-10 F	F-line
Barth	171 mm





Consult-PRO™

#1 RATED

Chairside™

The World Leader in Dental Patient Education

Spend less time **Explaining** Dentistry and more time **Doing** Dentistry

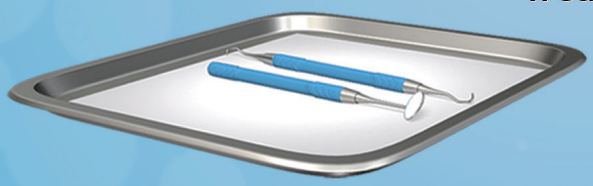

With over 800 3-D animated presentations that clarify:

The Need for Treatment ☑

Complex Concepts ☑



Treatment Recommendations ☑

Education Made Easy!

Consult-PRO is the leading manufacturer of dental patient education software. Educate your patients, motivate them to procede with treatment and create an efficent and patient-friendly office environement, with Consult-PRO's Chairside!

Call today! 416.429.6545 X2

www.consult-pro.com